



E.S.E. Hospital de Nazareth
Nit. 892.115.347-1
"Nuestra Prioridad es tu Salud"

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

E.S.E. HOSPITAL DE NAZARETH

VIGENCIA 2025




GERENTE ESE HOSPITAL DE NAZARETH


Calle 11 # 0-51 Segundo piso
Ciénaga del Rosario
Nazareth - Alto Cauca - Colombia


hospitalesnazareth@hznz.net


Telefax: 7285484
Cel: 3145630453


www.esehospitaldenazareth.gov.co

 ESE Hospital de Nazareth
 Nazareth ESE
 hospitalesnazareth



INDICE GENERAL

- 1. INTRODUCCIÓN.**
- 2. OBJETIVO GENERAL.**
- 3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.**
- 4. JUSTIFICACIÓN.**
- 5. PROCESO DE MANTENIMIENTO.**
- 6. FLUJOS DE TRABAJO.**
- 7. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.**
- 8. ANEXO 1 PRESUPUESTO DETALLADO POR EVENTO.**
- 9. ANEXO 2 RESUMEN PLAN DE MANTENIMIENTO 2024.**



1. INTRODUCCIÓN

El Hospital de Nazareth, único Hospital que presta servicio a la población Wayuu de la Alta Guajira, está ubicado en el corregimiento de Nazareth, a 6 horas por trocha de la cabecera municipal y atiende además los Centros de Salud de puerto Estrella, Siapana y Paraíso, lo mismo que los puestos de salud de Villa Fátima, Flor de la guajira y Warpana.

En el último censo tiene una población vinculada de más de 52.000 indígenas Wayuu diseminados por la Alta Guajira.

Por la dificultad de las comunicaciones debe estar muy bien dotado de infraestructura pues tiene que ser autosuficiente, ya que el corregimiento no cuenta con luz, agua y alcantarillado.

Los costos de mantenimiento son bastante elevados por las dificultades, falta de personal calificado, consecución de repuestos, falta de talleres, etc.

2. OBJETIVO GENERAL

- El objetivo general del plan de mantenimiento del Hospital de Nazareth es generar las herramientas necesarias para el perfecto funcionamiento de los servicios que presta el Hospital sin deterioro de su calidad.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Elaborar los cronogramas de mantenimiento preventivo y correctivo para prever paradas que puedan afectar la prestación de los servicios y optimizar los recursos tanto físicos como humanos con que cuenta el Hospital, Centros y Puestos de Salud.
- Preservar y conservar la estructura física de las edificaciones que conforman la Institución, tanto en su sede como en los Centros y Puestos de Salud.



- Asegurar el perfecto funcionamiento de los servicios de soporte de vida y servicios generales.
- Garantizar el buen funcionamiento de las áreas destinadas a la atención del paciente.
- Reducir gastos innecesarios por reparaciones imprevistas
- Contribuir con la seguridad del usuario y del mantenedor, así como la protección al medio ambiente.
- Apoyar a los programas extramurales con que cuenta la institución para garantizar su operatividad.

4. JUSTIFICACIÓN

El Plan de mantenimiento es una herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades inherentes a la prestación de los servicios de salud prestados por el Hospital, generando un flujo de los recursos necesarios a tiempo y de esta forma poder optimizar todos los trabajos de mantenimiento preventivo como correctivo.

5. PROCESO DE MANTENIMIENTO.

Área: Servicios generales			
Proceso: Mantenimiento Equipos			
Subproceso: Mantenimiento equipos			
Secuencia	Dependencia	Responsable	Descripción
1. Recibir solicitud de los diferentes servicios	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento	Recibir la solicitud de los servicios e informar al técnico de mantenimiento.



2. Entregar la solicitud al técnico de mantenimiento.	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Recibir la solicitud
3. Registrar trabajo en libro control.	Taller de mantenimiento equipos	Técnico de equipos	Registrar en orden cronológicos los trabajos recibidos
4. Diagnosticar el trabajo. ¿Se puede realizar en Taller del Hospital?	Taller de mantenimiento equipos	Técnico de equipos	Diagnosticar si el trabajo se puede realizar en nuestro taller o si es necesario remitirlo a un taller externo.
5. Si se puede realizar en el taller del hospital entonces solicitar materiales.	Taller de mantenimiento equipos.	Técnico de equipos	Solicitar material a la sección mantenimiento
6. Adquirir los materiales	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Ordenar compra de materiales por la caja menor del Hospital
7. Entregar materiales.	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Entregar materiales al técnico de equipos
8. Ejecutar el trabajo.	Taller de mantenimiento de equipos.	Técnico de equipos	Efectuar reparaciones
9. Registrar el trabajo terminado en el libro control	Taller de mantenimiento equipos	Técnico de equipos	Registrar en el libro control la fecha de entrega al servicio,




			obteniendo la firma de la sección mantenimiento
10. Entregar equipo reparado.	Taller de mantenimiento equipos	Técnico de equipos	Entregar a la sección mantenimiento el equipo o elemento reparado.
11. Si el trabajo va a realizar por contratación externa, entonces solicitar cotización.	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Enviar cotizaciones a la Gerencia para su aprobación
12. ¿Taller externo solicitado? Si, ordenar giro	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Enviar cotización aprobada al área financiera para su giro
13. Si el taller no solicita anticipo y el que lo solicito ya recibió pago, entonces elaborar orden de trabajo y autorización de salida de equipo o elementos.	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Elaborar orden de trabajo de acuerdo con lo cotizado y autorización de salida de equipos o elementos del hospital, documentos autorizados por el jefe de servicios generales.
14. Realizar trabajo	Taller externo	Técnico exterior	Técnico externo realiza trabajo




			ordenado en su taller
15. Recibir equipo reparado		Técnico de equipos	Recibir el equipo reparado junto con la factura o cuenta de cobro.
16. Registrar recibo de equipo en el libro de control.	Taller de mantenimiento equipos	Técnico de equipos	Registra en el libro de control el recibo del bien por el taller externo.
17. Entregar equipo al servicio	Taller de mantenimiento equipos	Técnico de equipos	Entregar al servicio el bien reparado y obtener firma de la sección mantenimiento en el libro control.
18. Enviar factura o cuenta de cobro al departamento financiero para su giro.	Sección mantenimiento	Jefe de mantenimiento o	Enviar factura o cuenta de cobro con Vd. Bo. Del sección mantenimiento y de la dirección de atención al paciente al área financiera, para su pago.

6. FLUJOS DE TRABAJO.

Solicitud de Servicio

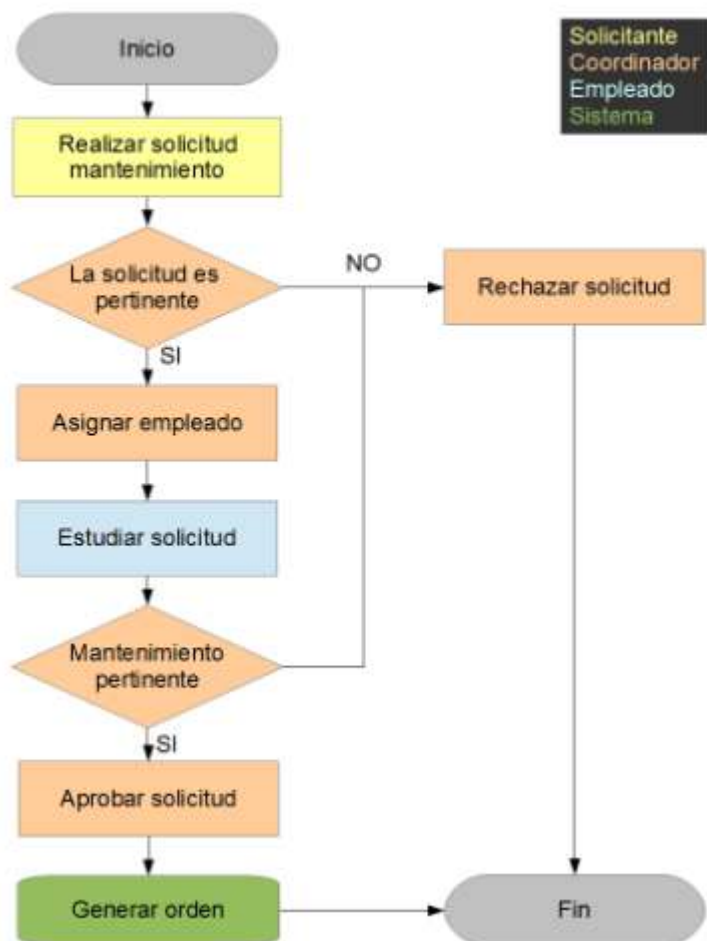

Orden Mantenimiento

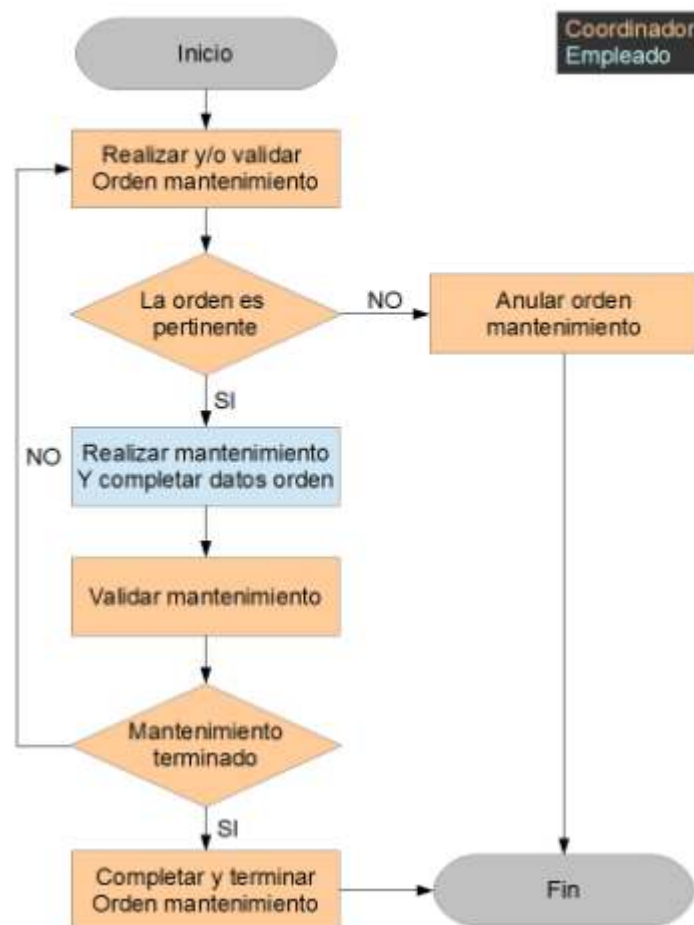



7. CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESCRIPCION	PERIODICIDAD	FECHA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA				
a. Edificios	DIARIO	Todo el año	PERSONAL MANTENIMIENTO	LIMPIEZA E INSPECCION
b. Instalaciones físicas	MENSUAL	Todo el año	PERSONAL EXTERNO	PINTURA, ARREGLO MAMPOSTERIA, GRIETAS CIELOS RAZOS, OBRAS DE CARPINTERIA, ETC.
c. Sistema de redes	SEMESTRAL	Febrero, agosto	PERSONAL EXTERNO	DESTAPE DE TUBERIAS AGUAS NEGRAS Y BLANCAS, LIMPIEZA TANQUE ELEVADO, LIMPIEZA DE REGISTROS Y POZAS SEPTICAS
d. Areas adyacentes	SEMANAL	Todo el año	PERSONAL MANTENIMIENTO	LIMPIEZA E INSPECCION
e. otros				
2, MANTENIMIENTO DE LA DOTACION				
2,1 EQUIPO BIOMEDICO				
a. de imágenes diagnosticas	TRIMESTRAL	Mar, junio.		VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. DOSIMETRIA.
b. de laboratorio	TRIMESTRAL	Mar,		CALIBRACION DE EQUIPOS,



c. de terapia, tratamiento y rehabilitación	TRIMESTRAL	Mar, jun, sept, dic		CALIBRACION DE EQUIPOS, PROTECCIONES ELECTRICAS.
3. EQUIPO INDUSTRIAL DE				
a. Plantas eléctricas	MENSUAL	Todo el año	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, ENGRASE.
b. Equipos de lavandería y cocina	SEMANAL	Todo el año	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	PRUEBA DE FUGAS
c. Bombas de agua	SEMANAL	Todo el año	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	PRUEBA DE FUGAS Y CEBAS
d. Autoclaves y esterilización	TRIMESTRAL	MAR, JUN		CAMBIO DE AGUA DEL CALDERIN, PRUEBA DE SELLADO
e. refrigeración y aire	TRIMESTRAL	MAR,		LIMPIEZA DE PANALES Y
f. Relacionados con servicios				
g. Vehículos	DIARIO	Todo el año	CONDUCTORES	VERIFICACION DE AGUA, ACEITE
	QUINCE	Todo el año	CONDUCTORES	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, ENGRASE
	MENSUAL	Todo el año		MANTENIMIENTO Y REVISION
4, Muebles de uso administrativo y asistencial	DIARIO	Todo el año	PERSONAL MANTENIMIENTO	LIMPIEZA E INSPECCION
5, EQUIPOS DE COMUNICACIONES E	CUATRIMESTRAL	Todo el año		REVISION DE CONEXIONES DE LAS REDES, LAS ANTENAS,

Nota:

El Hospital cuenta con la sección de mantenimiento a la cual recurren y apoyan todo el personal de Servicios generales y se distribuyen así:

JEFE DE SECCION: Es el encargado de distribuir el trabajo a las diferentes áreas.

AREA DE PLANTAS: 2 operarios encargados del mantenimiento de las plantas eléctricas, manejo de lubricantes y combustibles.



AREA ELECTRICA: 1 oficial de electricidad que se encarga de las redes tanto eléctricas como de informática.
(EXTERNO)

Todo el equipo anterior es interdisciplinario y deben colaborar en todas las áreas cuando en servicio así lo requiera.

ANEXO No 1
SNS 3000-PMH
NOMBRE DE LA INSTITUCION: ESE HOSPITAL DE NAZARETH
DIRECCION: CORREGIMIENTO DE NAZARETH
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL 2,025

Descripcion	Localizacion	No de inventario inventario	periodicidad	fecha d/m/a	responsable	Actividad	costo unitario	costo total
SISTEMA ELECTRICO	HOSPITAL DE NAZARETH	103	bimensual	feb, abr, jun, ag, oct, dic	PERSONAL EXTERNO	Limpieza y ajuste de contactos en caja de reparto, revision y limpieza de registros, revision de empalmes, revision y correccion de tomas e interruptores. Revision puestas a tierra	1.150.000	6.900.000
SISTEMA ELECTRICO	HOSPITAL DE NAZARETH	103	bimensual	feb, abr, jun, ag, oct, dic	PERSONAL EXTERNO	MANTENIMIENTO BATERIAS INERSORES SISTEMA DE EMERGENCIA REDES DE SISTEMAS Y FRIO	1.150.000	6.900.000
SISTEMA ELECTRICO	HOSPITAL DE NAZARETH	103	BIMENSUAL	feb, abr, jun, ag, oct, dic	PERSONAL EXTERNO	MANTENIMIENTO REDES EXTERNAS, BOMBAS ACUEDUCTOS, ILUMINACION EXTERIOR	1.150.000	6.900.000
PLANTA FISICA	HOSPITAL DE NAZARETH	104	mensual	ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ag, sep, oct, nov, dic	PERSONAL MANTENIMIENTO	DISPOSICION DE RESIDUOS	1.725.000	20.700.000
PLANTA FISICA	C. S. SIAPANA	104	UNICO	FEBRERO	PERSONAL EXTERNO	PINTURA GENERAL, ARREGLO DE CUBIERTA, CIELOS RASOS, PUERTAS, VENTANAS CASA DEL MEDICO	14.950.000	14.950.000
SISTEMA HIDRAULICO AGUAS BLANCAS	C. S. SIAPANA	101	UNICO	FEBRERO	PERSONAL MANTENIMIENTO	ARREGLO TANQUE ELEVADO, INSTALACION TURBINA SONDEO DE TUBERIAS CAMBIO DE LLAVES E INTERIORES SANITARIOS	5.750.000	5.750.000
SISTEMA HIDRAULICO AGUAS NEGRAS	C. S. SIAPANA	102	UNICO	FEBRERO	PERSONAL EXTERNO	LIMPIEZA DE POZAS, SONDEO DE TUBERIAS.	3.450.000	3.450.000
SISTEMA ELECTRICO	C. S. SIAPANA	103	UNICO	FEBRERO	PERSONAL EXTERNO	MEJORA INSTALACION DE SISTEMA SOLAR	23.000.000	23.000.000
PLANTA FISICA	C. S. PUERTO ESTRELLA	104	UNICO	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	RETOQUES PINTURA , ARREGLO DE CUBIERTA, CIELOS RASOS, PUERTAS, VENTANAS	11.500.000	11.500.000
SISTEMA HIDRAULICO AGUAS BLANCAS	C. S. PUERTO ESTRELLA	101	UNICO	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	ARREGLO TANQUE ELEVADO, INSTALACION TURBINA AGUAS LLUVIAS, SONDEO DE TUBERIAS CAMBIO DE LLAVES E INTERIORES SANITARIOS	5.750.000	5.750.000
SISTEMA HIDRAULICO AGUAS NEGRAS	C. S. PUERTO ESTRELLA	102	UNICO	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	LIMPIEZA DE POZAS, SONDEO DE TUBERIAS.	3.450.000	3.450.000
SISTEMA ELECTRICO	C. S. PUERTO ESTRELLA	103	ANUAL	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	MEJORA INSTALACION PLANTA SOLAR	23.000.000	23.000.000
PLANTA FISICA	C. S. PARAISO	104	UNICO	MAYO	PERSONAL EXTERNO	RETOQUES PINTURA , ARREGLO DE CUBIERTA, CIELOS RASOS, PUERTAS, VENTANAS	13.800.000	13.800.000
SISTEMA HIDRAULICO AGUAS BLANCAS	C. S. PARAISO	101	UNICO	MAYO	PERSONAL EXTERNO	ARREGLO TANQUE ELEVADO, INSTALACION TURBINA , SONDEO DE TUBERIAS CAMBIO DE LLAVES E INTERIORES SANITARIOS	2.300.000	2.300.000
SISTEMA HIDRAULICO AGUAS NEGRAS	C. S. PARAISO	102	UNICO	MAYO	PERSONAL EXTERNO	LIMPIEZA DE POZAS, SONDEO DE TUBERIAS.	3.450.000	3.450.000
SISTEMA ELECTRICO	C. S. PARAISO	103	UNICO	MAYO	PERSONAL EXTERNO	CAMBIO BANCO DE BATERIA	5.750.000	5.750.000
PLANTA FISICA	P S VILLA FATIMA	103	UNICO	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	ARREGLO CUBIERTAS CIELOS RASOS SISTEMA DE AGUAS BLANCAS Y NEGRAS PINTURA GENERAL PUERTAS Y VENTANAS SISTEMA ELECTRICO	11.500.000	11.500.000
PLANTA FISICA	P S VILLA FATIMA	103	UNICO	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	MEJORA SISTEMA SOLAR	11.500.000	11.500.000
PLANTA FISICA	PS FLOR DE LA GUAJIRA	103	UNICO	FEBRERO	PERSONAL EXTERNO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, MANTENIMIENTO A SISTEMA SOLAR, PINTURA, MANTENIMIENTO A POZA SEPTICA, MANTENIMIENTO A TANQUES DE AGUA, MANTENIMIENTO GENERAL A INFRAESTRUCTURA	80.500.000	80.500.000
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA LG MODELO: SJ112CD, SERIE: 006TGH02447	SUBDIRECCION CIENTIFICA	65900070012	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY	ARCHIVO	65900120013	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA SANKEY SERIAL D2014857000412A22130007B	PAGADURIA	65020130015	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922

AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY COLOR BLANCO CON GRIS	BODEGA FARMACIA	65900150018	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE CONDICIONADO MINI SPLIT MARCA ROYAL MODELO RSAD 128136	COORDINADOR DE FACTURACION	65020170016	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO BISTORION SERIAL	OFICINA P Y P	65020180014	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY FUNCION INVETER	ESTADISTICAS	6590020014	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE MINI SPLIT ROYAL TITANI GOLD MODELO RSAD-24886 S/N RS248ATV900151L	FACTURACION 3	65020210005F3	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO SPLIT PANORAMA UPRISE 18000 BTU	FACTURACION 3	65020210006F3	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL MARCA LENNOX LXGMUB36CR COMFOR FREHS S/N 8963F36427 36MIC	LABORATORIO	65900220078	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA ROYAL THANGOLD MODELO RSAD-248BQ S/N RS248APY900046L	CITOLOGIA	6590023020	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO ROYAL BLANCO	VACUNACION	65020240012	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO BISTORION SERIAL	CUARTO FRIO	65020250005-000	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922

AIRE ACONDICIONADO BIGSTRON	MANTENIMIENTO	65020260002	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE MINI SPLIN MARCA LG MODELO SJ122CO S/N 90EX3660910TACX01755	ADMISIONES 1	6590029009	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE MINI SPLIT MARCA ROYAL 18000 BTU MODELO: RSAD-18	FARMACIA	65900310026	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO SANKEY MODELO ES-18IN20 8000 BTU	COPIAS	65900320007	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA MILEXUS MODELO ML-SPAC-12K	CONSULTORIO MEDICO 1	65900330030	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY FUNCION INVERTER ES - 121NV32	CONSULTORIO MEDICO 3	65900350025	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLING MARCA SANKEY	CONSULTORIO MEDICO 4	65900360030	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE SANKEI ES 12073E 12000 BTU	CONSULTORIO MEDICO 5	65900370017	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA SANKEY ES-12073D 12000 BTU AF06130335	ODONTOLOGIA 1	60070380008	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA ROYAL SERIAL RSAD12	ODONTOLOGIA 2	60050390002	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922

AIRE ACODICIONADO MINI SPLING MARCA LG S/N 2D1X00N8- 212THKO1413	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	60090400027	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO SPLIT PANORAMA UPRISE 18000 BTU	RAYOS X	65900430014	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLING MARCA LG SERIAL 006EX1281- 006TAMAU2331 COLOR BLANCO	CUARTO MEDICO	65020450015	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA: LG, MODELO: 242CS, SERIE: 503KAPB04784	HOSPITALIZACION	65900460095	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA: LG, MODELO: 242CS, SERIE: 511KASL00750	SALA DE CIRUGIA	60050470011	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA: LG, MODELO: 242CS, SERIE: 508KALC00632	SALA DE PROCEDIMIENTO	65900490005	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA: LG, MODELO: 242CS, SERIE: 511KAAE00832	SALA DE PARTO	65020500015	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLING MARCA LG, MODELO: 242CS, SERIE 511KAMZ00755	SALA DE BIOPSIA	65900510005	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA LG MODELO M483CS SERIAL 411KAAE01976	PEDIATRIA	65900560090	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA SANKEY 1 MALO	PEDIATRIA	65900560091-005	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIG MARCA LG SERIAL 93EX2095- 903TADRO8043	OFICINA RIOHACHA	65020610007	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTFRESH MODELO K5036	OFICINA RIOHACHA	65020610035	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIG MARCA LG	OFICINA RIOHACHA	65020610050	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO BIGSTRON	MANTENIMIENTO	65020260002	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO SPLIT PANORAMA UPRISE 18000 BTU	ALMACEN	65020140014	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
AIRE ACONDICIONADO SPLIT MILEXUS	ALMACEN	65020140015	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA MINIBAR COLOR BLANCA NEVERA MARCA ICASA	GERENCIA	80020010012	TRIMESTRAL	MARZO/JUNIO/SEPTIEMBRE /DICIEMBRE	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA PARA REACTIVOS MARCA THERMO SCIENTIFIC MODELO	LABORATORIO	60020220014	TRIMESTRAL	MARZO/JUNIO/SEPTIEMBRE /DICIEMBRE	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
FRIZEER MARCA VEST FROST MODELO MK304 S/N 20094169358 DONACION UNICEF	CUARTO FRIO		TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922

FRIZEER MARCA VESTFROST SOLUTIONS VLS400 GREENLINE SERIAL # 20151801255	CUARTO FRIO		TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
FRIZEER MARCA VESTFROST SOLUTIONS MF314 SERIAL # 20160343503	CUARTO FRIO		TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA BLANCA MARCA ABBA	FARMACIA	80020310029	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA MARCA WONDER SI MANO MODELO ANTIGUO TAMAÑO MEDIANA DE UNA PUERTA COLOR BEIS	ODONTOLOGIA 1	60050380003	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA MARCA WONDER DE UNA PUERTA COLOR BEIS TAMAÑO MEDIANO	CUARTO MEDICO	80020450016	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
FREEZER INDUSTRIAL DE 6 COMPARTIMIENTO MARCA FRIO - NORTE SN-4461	COCINA		TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA MARCA ICASA SERIAL 80859161 DE 120 gr COLOR GRIS	PEDIATRIA	80020560094	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA MARCA CHALLENGER MODELO CV430 S/N 10053096 DONACION	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	80020620171	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
NEVERA SANYO S/N 990744536 RO COLOR BLANCO PEQUEÑA	CENTRO DE SALUD SIAPANÁ	80020630119	TRIMESTRAL	MARZO, JUNIO, SEP Y DIC	CRESPO SOLUCIONES INGRALES	limpieza integral externa e interna del equipo. Verificar estado de empaques y bisagras, capacitores, termostato. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo.	290.640	1.010.922
ASPIRADOR 350 WATTS 13000 RPM GRIS	LABORATORIO	60080160001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional. Verificación de manguera	95.441	331.967
ANALIZADOR DE QUIMICA MARCA BIOSYSTEMS MODELO BTS-350 SERIAL 801755172	LABORATORIO	60020220004	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico. Ajuste . Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967

CENTRIFUGA MARCA CLAYADAMS MODELO COMPACTLL SERIAL 3500278449	LABORATORIO	60020220007	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	TECNOVITAL	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
CENTRIFUGA MARCA CLAY ADAMS MODELO 420352 SERIAL 4230102	LABORATORIO	60020220008	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
CENTRIFUGA MARCA CLAY ADAMS MODELO 420225 SERIE 4340061 12 PTO	LABORATORIO	60020220009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
PIANO CUENT CELULA MARCA KRAMER MODELO IMP001 SERIAL 885	LABORATORIO	60020220016	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de valvas rectas y curvas, Verificación de estado de bateria, Verificación de estado de bombillo, Verificación de estado de fibra optica, Verificación de sistema eléctrico y encendido, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
TERMOMETROS DIGITAL BLANCO	LABORATORIO	60020220019- 0020	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
INCUBADORA MICROBIOLOGICA MARCA MEMMERT MODELO INE 200 SERIE E207-0206	LABORATORIO	60050220023	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 2016-01 al 32	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico , Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de estado de bateria, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Prueba de test de usuario, Verificación de estado de pantalla y de panel de teclado , Verificación de mando de selección de modo, Verificación de modo desfilibrador, Verificación de modo monitor, Prueba des activación de energia, Verificación estado de cable de alimentación, Verificación de configuración de menu, Chequeo indicador de fuente (indicador luminoso verde), Prueba de carga 1J, Prueba de carga 100J, Prueba de carga 360J, Verificación de paletas adultas/pediatricas, Verificación de paletas adultas/pediatricas (desechables), Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de modo marcapasos, Verificación de modo DEA	95.441	331.967
ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA MARCA DIATRON MODELO ABACUS 380 SERIAL 64185	LABORATORIO	60070220024	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Bateria, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Manguera y Brazaletes de NIBP, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Saturación de Oxígeno en la sangre (SpO2), Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de EKG y electrodos, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Temperatura (Piel), Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros SpO2 Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros NIBP Adulto - Neonato, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros EKG Adulto, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros Temperatura, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros IBP , Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Modulo de Capnografía, Inspección general de Dispositivo Medico - Cargador de batería Externo, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación funcional de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Bateria, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Manguera y Brazaletes de NIBP, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Saturación de Oxígeno en la sangre (SpO2), Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de EKG y electrodos, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Temperatura (Piel), Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros SpO2 Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros NIBP Adulto - Neonato, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros EKG Adulto, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros Temperatura, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros IBP , Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Modulo de Capnografía, Inspección general de Dispositivo Medico - Cargador de batería Externo, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación funcional de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Bateria, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de transductor , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (suiche on/off, Parlante, potenciómetro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967
BALANZA GRANATARIA MARCA OHAUS MODELO 2610G-5LB	LABORATORIO	60090220027	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Bateria, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de transductor , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (suiche on/off, Parlante, potenciómetro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967
AUTOCLAVE MARCA BACK SIDE ELECTRI PORTATIL (OLLA ESTARILIZADORA)	LABORATORIO	60900220028	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Bateria, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de cable de paciente, latiguillos, chupas y pinzas, Verificación de Sistema electrónico , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (pantalla LCD, pulsadores, suiches, tarjeta electrónica), Verificación de estado de bateria, Verificación de estado de impresora y papel, Verificación de parámetros de programación, Verificación con simulador de funcionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967

HORNO ESTERILIZADOR MARCA MEMMERT MODELO UM100 SERIAL 6197-04	LABORATORIO	60900220029	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Manguera y Brazaletes de NIBP, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Saturación de Oxígeno en la sangre (SpO2), Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de EKG y electrodos, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Temperatura (Piel), Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros SpO2 Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros NIBP Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros EKG Adulto, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros Temperatura, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros IBP , Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Modulo de Capnografía, Inspección general de Dispositivo Medico - Cargador de batería Externo, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación funcional de Dispositivo Medico - Impresora sistema Verificación de Set de Chupos y	95.441	331.967
BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT MODELO W-270 SERIAL 810-189	LABORATORIO	69920220079	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de transductor , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (suiche on/off, Parlante, potenciómetro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967
MICRO CENTRIFUGA MARCA CLAY ADAMS SERIAL AC- 18010	LABORATORIO	60020220098	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de cable de paciente, latiguillos, chupas y pinzas, Verificación de Sistema electrónico , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (pantalla LCD, pulsadores, suiches, tarjeta electrónica), Verificación de estado de batería, Verificación de estado de impresora y papel, Verificación de parámetros de programación, Verificación con simulador de funcionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MICROCENTRIFUGA MARCA CLAYADAMS MODELO 420225 SERIAL 4420011	LABORATORIO	#N/D	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LABOMED MODELO LX400 SERIAL 131262921	LABORATORIO	60020220113	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MICROSCOPIO MARCA OLYMPUS MODELO CX31RBSFA SERIE 4C08642	LABORATORIO	60020220114	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
MICROSCOPIO MARCA OLYMPUS TOKIO (RELIQUIA)	LABORATORIO	60020220115	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
LAMPARA CUELLO DE CISNE	LABORATORIO SALA DE ESPERA	60060220129	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
COLPOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN MODELO 906057 SERIAL AW7V7	CITOLOGIA SALA		Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre 2016-01 al 32	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MICROSCOPIO MARCA OLYMPO MODELO CX31	CITOLOGIA SALA	65020230047	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
TERMOMETROS LASER INFRARROJO FS 300	VACUNACION	60090240032-0062	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967

TERMOMETRO DIGITAL	CUARTO FRIO	60090250007-0009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazalete, Verificación de Pera y Válvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - displav), Verificación de Sistema electrónico (varieta, bomba de	95.441	331.967
COMPRESOR DE AIRE MARCA CAMPBELL HAUSFELB MDD MT330004 S/N DK303502AV	MANTENIMIENTO	55900260007	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
NEBULIZADOR MARCA THOMAS SN:1145	URGENCIAS	60090270011	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698183	URGENCIAS	60090270013-0014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
LAMPARA CUELLO DE CISNE	URGENCIAS	60060220129	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
ECOGRAFO MARCA FUKUDA DENSHI MODELO UF -4100 SERIAL 351531297 COLOR BEIS	CONSULTORIO MEDICO 1	60070330003	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
ECOGRAFO SOUND SCAPE MOD A6, TRANSDUCTOR CONVEXO A6 C351, TRANS. TRASVAG. A6 6V4 SN 26386320	CONSULTORIO MEDICO 1	60070330005	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
NEGATOSCOPIO DOBLE MARCA KRAMER MODELO N/A SERIAL N/A	CONSULTORIO MEDICO 1	60070330006	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
BASCULA PESA ADULTO MARCA ELECTRONIC BODY SCALE TCS-200-RT	CONSULTORIO MEDICO 1	60090330009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN	CONSULTORIO MEDICO 1	60090330012	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Válvulas y Electroválvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
TENSIOMETRO PARED MARCA WELCH ALLYN MODELO 7670-01 SERIAL 140614001785	CONSULTORIO MEDICO 1	60090330014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico (cabina - modulo - gabinetes y bases), Verificación de la puerta frontal, Verificación de cierres y pestillos, Verificación de la operación de la cabina, Verificación de las ventanas y seguros, Verificación de la puerta de entrada tipo Iris, Verificación de la inclinación (Trendelemburg), Verificación del filtro de aire, Verificación física interna del modulo de control, Verificación de alarma sin sensor de temperatura, Verificación de alarma sin fluido eléctrico, Verificación funcional en los modos, Verificación de la temperatura Máxima / Mínima, Verificación de alarmas visuales y audibles, Verificación de alarma de Piel, Verificación de alarma de Aire, Verificación de alarma de desviación, Verificación de sistema de transporte, Verificación de sistema de anclaje a ambulancia, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967

TENSIOMETRO PORTATIL	CONSULTORIO MEDICO 2	60090340009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
BASCULA DIGITAL ELECTRONIC BODY	CONSULTORIO MEDICO 2	60090340014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza general de los cables, mangueras, sensores, accesorios y Dispositivo Medico, Verificación de teclado y pantalla (suiches, pulsadores,perillas), Verificación de ventilador y circuito ventilatorio y valvulas, Verificación de sistema electronico, Verificación de Sistema Mecanico/Neumatico, Verificación de estado de manguera, fuelle y canister, Verificación de funcionamiento de la valvula APL, Verificación de funcionamiento manometro de presión, Estado funcional de la valvula PEEP, Funcionamiento del sensor de flujo, Estado de la línea sensora de presión, Funcionamiento del sensor O2, Prueba de volumen tidal, Prueba de Frecuencia respiratoria, Prueba de Relación I/F, Prueba FIO2	95.441	331.967
NEGATOSCOPIO DOBLE MARCA KRAMER MODELO N/A SERIAL N/A	CONSULTORIO MEDICO 2	60070330006	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (cable de alimentación y suiche de encendido), Verificación de Sistema y Componentes Mecanicos, Verificación de estado de frasco de reservorio, Verificación de estado de mangueras y filtro Hidrofobico, Chequeo de fugas, Verificación de estado de manómetro de presión, Verificación de estado de motor pistones, rodamientos y ventilador, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de estado de pedal, Verificación de vacuometro (+/-1%), Verificación de válvula selectora, Prueba de Vacio máxima 600mmhg (+/- 5%), Verificación de estado de soporte y sistema de rodamiento, Ajuste y lubricación de sistema mecanico, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
CARRO DE PARO COLOR AMARILLO AMBULANCIA	CONSULTORIO MEDICO 3	60030350004	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de	95.441	331.967
NEGATOSCOPIO DOBLE MARCA KRAMER MODELO N/A SERIAL N/A	CONSULTORIO MEDICO 3			Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre			95.441	331.967
BALANZA CON TALLIMETRO DIGITAL MARCA DETECTO MODELO 20KG ACS-20BYE SERIAL 10029583	CONSULTORIO MEDICO 3	60090350009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarieta, bomba de	95.441	331.967
BASCULA PARA BEBE MARCA DETECTO COLOR BLANCO	CONSULTORIO MEDICO 3	60090350010	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
BASCULA PESO DE ADULTO MARCA KENWELL 160G	CONSULTORIO MEDICO 3	60090350011	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO MARCA WELCHALLYN	CONSULTORIO MEDICO 3	60090330012	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
TENSIOMETRO PARED MARCA WELCH ALLYN MODELO 7670-01 SERIAL 140814220175	CONSULTORIO MEDICO 3	60090350015	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico (cabina - modulo - gabinetes y bases), Verificación de la puerta frontal, Verificación de cierres y pestillos, Verificación de la operación de la cabina, Verificación de las ventanas y seguros, Verificación de la puerta de entrada tipo Iris, Verificación de la inclinación (Trendelemburg), Verificación del filtro de aire, Verificación física interna del modulo de control, Verificación de alarma sin sensor de temperatura, Verificación de alarma sin fluido eléctrico, Verificación	95.441	331.967
NEGATOSCOPIO DOBLE MARCA KRAMER MODELO N/A SERIAL N/A	CONSULTORIO MEDICO 4			Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre			95.441	331.967
BALANZA CON TALLIMETRO DIGITAL MARCA DETECTO MODELO 20KG ACS-20BYE SERIAL 10029583	CONSULTORIO MEDICO 4	60090350009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos, Verificación de manómetro: indicador y aguja, Verificación de fugas de aire, Inspección general de Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de conectores	95.441	331.967
FONENDO	CONSULTORIO MEDICO 4	60090360013	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de valvas rectas y curvas, Verificación de estado de batería, Verificación de estado de bombillo, Verificación de estado de fibra optica, Verificación de sistema eléctrico y encendido, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
PESO PARA RECIEN NACIDO MARCA AWS	CONSULTORIO MEDICO 4	60090360014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967

PESO PEDIATRICO AUS BLANCO DIGITAL (DONACION)	CONSULTORIO MEDICO 4	60090360015	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazalete, Verificación de Pera y Válvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (mantalla - displav), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
TENSIOMETRO MARCA WELCHALLYN SERIAL 100719174513	CONSULTORIO MEDICO 4	60090360018	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de soporte frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
NEGATOSCOPIO DOBLE MARCA KRAMER MODELO N/A SERIAL N/A	CONSULTORIO MEDICO 5	60070330006	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
BASCULA DIGIAL	CONSULTORIO MEDICO 5	60090370004	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
COMPRESOR MARCA SCHULZ	ODONTOLOGIA 1	60050380005	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
AMALGAMADOR MARCA SATELER MODELO SOFTLY 8 SERIAL 9586	ODONTOLOGIA 1	60080380012	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (cable de alimentación y suiche de encendido), Verificación de Sistema y Componentes Mecanicos, Verificación de estado de frasco de reservorio, Verificación de estado de mangueras y filtro Hidrofobico, Chequeo de fugas, Verificación de estado de manómetro de presión, Verificación de estado de motor pistones, rodamientos y ventilador, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de estado de pedal, Verificación de vacuometro (+/-1%), Verificación de válvula selectora, Prueba de Vacio máxima 600mmhg (+/- 5%), Verificación de estado de soporte y sistema de rodamiento, Ajuste y lubricación de sistema mecanico, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GAD DENTAL	ODONTOLOGIA 1	60080380015	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación , Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación , Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967
ESTERILIZADOR EQUIPO DE ENDODONCIA	ODONTOLOGIA 1	60090390023	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
AUTOCLAVE AUTOMATICO MARCA MINIKLAV-GV MODELO 21-34 SERIAL 14111476	ODONTOLOGIA 1	60080440001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema electrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Electrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
COMPRESOR MARCA CLON REEMSAMPLADO	ODONTOLOGIA 2	60070620209-021	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de soporte frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
COMPRESOR PORTATIL TROPIC	ODONTOLOGIA 2	60090620212	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de conector chemetron, Verificación de estado de cubierta exterior plastica,tubo gradual y flotador, Verificación de conexiones de entrada y salida, Verificación de estado de válvula reguladora, Verificación de flujo, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967

HORNO ESTERILIZADOR MARCA BIODENTAL COLOR BEIS MEDIANO	ODONTOLOGIA 2	55040630145	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de valvas rectas y curvas, Verificación de estado de batería, Verificación de estado de bombillo, Verificación de estado de fibra optica, Verificación de sistema eléctrico y encendido, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
LAMPARA DE FOTOCURADO MARCA SUNLITE MODELO 1275	ODONTOLOGIA 2	60070660051	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación de estado físico funcional, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de estado de fuente de luz, Verificación de estado de bombillo, Verificación de estado de oculares y filtros, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema de transporte y freno, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MICROMOTOR	ODONTOLOGIA 2	60070620209-021	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza general del equipo y accesorios, Verificación de conectores de manguera, Verificación de regulador de presión, Chequeo de fugas, Verificación de estado de punta para criocauterizar	95.441	331.967
MICROMOTOR	ODONTOLOGIA 2	60090620212	Mensual	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema eléctrico y electrónico, Verificación de componentes eléctricos y electrónicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de oculares, Verificación de objetivos, Verificación de sistema de iluminación e intensidad luminica., Verificación de filtros de luz, Verificación de sistema y componentes mecánico, Lubricación de rodamientos, piñones y baline, Verificación Funcional de Dispositivo medico	95.441	331.967
ESTERILIZADOR EQUIPO DE ENDODONCIA	ODONTOLOGIA 2	55040630145	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema eléctrico y electrónico, Verificación de componentes eléctricos y electrónicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de oculares, Verificación de objetivos, Verificación de sistema de iluminación e intensidad luminica., Verificación de filtros de luz, Verificación de sistema y componentes mecánico, Lubricación de rodamientos, piñones y baline, Verificación Funcional de Dispositivo medico	95.441	331.967
PIEZA DE MANO DE ALTA	ODONTOLOGIA 2	60090640102	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos, Verificación de manómetro: indicador y aguja, Verificación de fugas de aire, Inspección general de Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GAD DENTAL	ODONTOLOGIA 2	60090390023	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de puerta y seguro de puerta, Verificación de puerta y seguro de puerta, Verificación de cargador, Lubricación y ajuste de sistema de puerta, Verificación de configuración de menu, Prueba de test de display, Prueba de test de teclado, Prueba de test de alarmas, Prueba de test de apertura de puerta, Prueba test de sensor de aire, Verificación de Presión sin circuito CH1 (48 a 52), Verificación de Presión con circuito CH1 (60 a 120), Verificación de Prueba de infusión CH1 (200ml/h 10ml +/-5%), Verificación de Presión sin circuito CH2 (48 a 52), Verificación de Presión con circuito CH2 (60 a 120), Verificación de Prueba de infusión CH2 (200ml/h 10ml +/-5%), Verificación de Presión sin circuito NOA3, Verificación de Presión con circuito NOA3, Verificación de Prueba de infusión NOA3 (200/10)ml/h(50%), Lectura Potenciometro CH1, CH2 (0.5-4.5V, Verificación de Tensión de la Batería (0	95.441	331.967
SCALER MARCA GADDENTAL	ODONTOLOGIA 2	60080440001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
BASCULA MARCA SECA PARA ADULTO MODELO 874 679	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	60070620209-021	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazalete, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara, Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarieta, bomba de	95.441	331.967
TENSIOMETRO MARCA WELCH ALLYN MODELO TYCOS SERIAL SN100719141102 - FONENDOSCOPIO	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	60090620212	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia, Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
UNIDAD DE RADIOGRAFIA - EXPLOR-X MODELO POLYMOBIL III SERIAL 01851-516	RAYOS X	55040630145	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia, Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico,	95.441	331.967

UNIDAD DE RADIOGRAFIA MARCA SIEMENS MODELO POLYMOBIL SERIAL 01851-516	RAYOS X	60070660051	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación, Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación, Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967
UNIDAD DE RAYOS X MARCA VISITOR T30 (FUERA DE SERVICIO)	RAYOS X	60080380024	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación, Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación, Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA STANLEY MODELO N/A SERIAL N/A	BRIGADA ODONTOLOGIA	60080440001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de pantalla Display - LCD, Verificación de lampara, Verificación de filtros de luz, Verificación de bomba peristaltica, Verificación de parámetro de programación, Verificación de parámetro de programación, Verificación sistema neumático y mangueras siliconada, Verificación Funcional de	95.441	331.967
PIEZA DE ALTA NSK	BRIGADA ODONTOLOGIA	60070620209-021	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de pantalla Display - LCD, Verificación de lampara, Verificación de filtros de luz, Verificación de bomba peristaltica, Verificación de parámetro de programación, Verificación de parámetro de programación, Verificación sistema neumático y mangueras siliconada, Verificación Funcional de	95.441	331.967
PIEZA DE BAJA NSK	BRIGADA ODONTOLOGIA	60090620212	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de contador, Verificación de piñones y teclas, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de pantalla Display - LCD, Verificación Funcional de	95.441	331.967
LAMPARA DE FOTOCURADO MARCA SUNLITE MODELO 1275 SERIAL 8302	BRIGADA ODONTOLOGIA	55040630145	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia, Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
DESFILBRADOR NIHON KOHDEN	HOSPITALIZACION	60070660051	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación, Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros,	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698163	HOSPITALIZACION			Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre			95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698164	HOSPITALIZACION	60050460022	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698176	HOSPITALIZACION	60050460023	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698183	HOSPITALIZACION	60090270013-0014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698184	HOSPITALIZACION	60050460025	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH 04	HOSPITALIZACION	60050460026	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema electrico y electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de oculares, Verificación de objetivos, Verificación de sistema de iluminación e intensidad lumínica., Verificación de filtros de luz, Verificación de sistema y componentes mecánico, Lubricación de rodamientos, piñones y baline, Verificación Funcional de Dispositivo medico	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH 05	HOSPITALIZACION	60050460027	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación, Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación, Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967

CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH-01	HOSPITALIZACION	60050460028	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación , Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación , Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH-02	HOSPITALIZACION	60050460029	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación , Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación , Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH-03	HOSPITALIZACION	60050460030	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Sistemas y Componentes Electricos, Verificación de componentes de alimentación , Verificación de Sistema Mecanicos - Motor, Verificación de las Revoluciones Por Minutos del equipo VS la programación (comparativo), Verificación de la plataforma o soporte de tubos, Verificación de sistemas de programación de parametros, Verificación de parámetro de programación , Verificación de control R.P.M y Tiempo, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de bandejas, Verificación de Sistemas de aislamientos de refrigeración, Prueba	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH-07	HOSPITALIZACION	60050460031	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de contador, Verificación de piñones y teclas, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de pantalla Display - LCD, Verificación Funcional de	95.441	331.967
RESPIRADOR PORTATIL PULMO AY MARCA BIRD AVIAN SERIAL 6530-01374-8903 (DONACION)	HOSPITALIZACION	60050460036	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza general del equipo , Verificación de estado físico funcional, Verifican de voltaje, Verificación y chequeo de Filtro EPA, Verificación de funcionamiento y Flujo de aire, Verificación de estado de lampara Uv	95.441	331.967
ELECTROCARDIOGRAMA MARCA EDAN MODELO SE60TC SERIAL 50HZ160HZ	HOSPITALIZACION	60070460038	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
ELECTROCARDIOGRAMA MARCA SMART ECG MODELO SE-3 SERIAL SE30641331ZA	HOSPITALIZACION	60070460039	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
NEBULIZADOR	HOSPITALIZACION	60080460041	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
TENSIOMETRO ALR K2 1969 PORTATIL	HOSPITALIZACION	60090460052	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN SERIAL M8B301076752LD	HOSPITALIZACION	70020460096	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO CADENCE II SERIAL CB3031078594DEH	HOSPITALIZACION	70020460097	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
SUCCIONADOR MARCA THOMAS MODELO 1240 SERIAL 7040001110	SALA DE CIRUGIA	60050470001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
TENSIOMETRO MARCA WELCHALLYN MODELO PERED SERIAL 90492024	SALA DE CIRUGIA	60050470002	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA NACIONAL	SALA DE CIRUGIA	60050470007	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
DEFIBRILADOR MARCA MINDRAY MOD BENEHEART D3 SN 52019120	SALA DE CIRUGIA	60050470018	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Limpieza externa - interna del DM, Inspección de estado físico y funcional de DM, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos: embolo, bastago, cono, contador, empuñadura, Verificación de volumen, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MONITOR E SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY IMEC 10 SN 0652B PA00140	SALA DE CIRUGIA	60050470018	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de contador, Verificación de piñones y teclas, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de pantalla Display - LCD, Verificación Funcional de	95.441	331.967

AUTOCLAVE MARCA MIC MODELO 121LTS	AUTOCLAVE	60900480004	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de DM, Limpieza externa - interna del DM, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sensores, Verificación de batería , Verificación de parámetro de programación , Verificación de ajuste de alarmas, Verificación de sensado de humedad, Verificación Funcional de	95.441	331.967
LAMPARA MEDICO -QUIRURGICA MARCA ILUMITEC MODELO CBR 105 SERIAL 38327 COLOR BALCO	SALA DE PROCEDIMIENTO	60100490001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de Componentes Elctricos Electronicos, Verificación de Componentes Elctricos Electronicos, Verificación de pantalla Display - LCD, Verificación de lampara, Verificación de filtros de luz, Verificación de bomba peristaltica, Verificación de parámetro de programación , Verificación de parámetro de programación , Verificación sistema neumático y mangueras siliconada, Verificación Funcional de Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes Elctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manómetro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
CARRO DE PARO DE 4 COMPARTIMENTOS	SALA DE PROCEDIMIENTO	60090490006	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de DM, Limpieza externa - interna del DM, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sensores, Verificación de batería , Verificación de parámetro de programación , Verificación de ajuste de alarmas, Verificación de sensado de humedad, Verificación Funcional de	95.441	331.967
TENSIOMETRO MARCA WELCH ALLYN MODELO TYCOS SERIAL 090492024 DE PARED	SALA DE PROCEDIMIENTO	60090490011	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de DM, Limpieza externa - interna del DM, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sensores, Verificación de batería , Verificación de parámetro de programación , Verificación de ajuste de alarmas, Verificación de sensado de humedad, Verificación Funcional de	95.441	331.967
INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA MEDIX MODELO TR-200 SERIAL 1829-10 - - DONACION	SALA DE PARTO	60050500001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación estado Dispositivo Medico., Verificación sistema eléctrico, Verificación de componentes eléctrico: Balastro, Socket, Suiche, Verificación de tubo fluorescente, Verificación de clavija o conector de poder (110V), Verificación Funcional de Dispositivo medico	95.441	331.967
SUCCIONADOR PEQUEÑO MARCA THOMAS MODELO 1130	SALA DE PARTO	60050500002	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de parámetro y funciones, Verificación de transductor - Convexo, Verificación de transductor transvaginal, Verificación de transductor- Lineal, Verificación de sistema mecánicos, Verificación de posicionamiento y freno de brazo y tubo, Verificación de KA, Verificación de rayo, Verificación de parámetros de programación, Prueba funcional de Dispositivo Medico, verificación de colimador - revisión de panel de funciones de KV y mA	95.441	331.967
LAMPARA CIELITICA DE 2 2 BRAZOS MASRCA MINDRAY SERIAL G1E45002828	SALA DE PARTO	60050500003	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display) Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
PESO DIGITAL NEONATAL MARCA WELCH ALLYN HEALTH O METER	SALA DE PARTO	60050500004	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Elctrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN MODELO TYCOS SERIAL 080489423	SALA DE PARTO	60050500006	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
BASCULA DIGITAL COLOR GRISDE BEBE MARCA WELCH ALLYN	SALA DE PARTO	60050500016	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display) Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
UNIDAD CALOR RADIANTE MARCA DAVID MODELO HKN-93B SERIAL 24140602001	SALA DE PARTO	60090380027	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallmetro	95.441	331.967
MESA GINECOLOGICA	SALA DE PARTO	60060500031	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación estado Dispositivo Medico., Verificación sistema eléctrico, Verificación de componentes eléctrico: Balastro, Socket, Suiche, Verificación de tubo fluorescente, Verificación de clavija o conector de poder (110V), Verificación Funcional de Dispositivo medico	95.441	331.967

LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA NACIONAL	SALA DE BIOPSIA	60050470007	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Eléctrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
CARRO DE PARO DE ACERO DE 5 COMPARTIMIENTOS NIQUELADO	SALA DE RECUPERACION	60080520001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Eléctrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
PESO MARCA LA PRECISA CPACIDAD DE 60 libras X onzas	COCINA	60090540002-0003	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CARRO DE PARODE 5 COMPARTIMIENTOS NIQUELADO	PEDIATRIA	60030560014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B8684-5 SERIAL CH-09	PEDIATRIA	60050560024	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH-06	PEDIATRIA	60050560025	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH 08	PEDIATRIA	60050560026	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara, Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (mantalla - rjislav), Verificación de Sistema electrónico (tarieta, bomba de	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MARCA HOPEFULL MODELO B868Y-S SERIE CH-03	PEDIATRIA	60050460030	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
CAMA HOSPITALARIA MODELO MECANICA CON COLCHON	PEDIATRIA	60050560028	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CAMA PARA TRANSPORTAR PACIENTE MARCA HOPEFULL MODELO B8684-5	PEDIATRIA	60050560029	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA NACIONAL	PEDIATRIA	60050470007	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Eléctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de sistema Hidraulico, Verificación de estado de sillón, Verificación de escupidera y bandeja, Verificación de negatoscopio, Verificación de Pieza de alta, Verificación de Pieza de baja, Verificación de Jeringa triple, Verificación de pedal, Verificación estado de lampara, Verificación de tanque reservorio de agua potable, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de	95.441	331.967

NEBULIZADOR MARCA DELBISS 714	PEDIATRIA	60080560051	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación Sistema Electrico, Verificación de sistema y Componentes Electricos, Verificación de pantalla o panel frontal, Verificación de pulsadores y perillas de encendido y programación, Verificación de porta capsula , Verificación de parámetros de programación, Verificación de Revoluciones por minuto (R.P.M), Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
BASCULA PESO DE ADULTO MARCA KENWELL 160G	PEDIATRIA	60090350011	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de Sistema y Componentes Eléctricos - Electrónico, Verificación de fugas de aire y agua , Inspección general de Dispositivo Medico, Verificación de mangueras y fugas de aire/agua, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
FONENDO MARCA LITTMANN QUALITY	PEDIATRIA	60090560053	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de soporte frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
TENSIOMETRO MARCA SPHYGMONANOMETER MODELO TYCOS SERIAL 9610251369	PEDIATRIA	60090560057	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación estado Dispositivo Medico., Verificación sistema electrico, Verificación de componentes eléctrico: Balastro, Socker, Suiche, Verificación de tubo fluorescente, Verificación de clavija o conector de poder (110V), Verificación Funcional de Dispositivo medico	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION MADRE BEBE SECA 874 SN 5874256143238	CONVENIO 423	6009058002	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electronicos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
balanza doble funcion madre / bebe seca 874 SN 5874196139863	CONVENIO 423	6009058003	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema electrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Electrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION SECA SN 5874061161345	CONVENIO 423	6009058004	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION MARCA SECA SN 5874320152545	CONVENIO 423	6009058005	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de sistema Hidraulico, Verificación de estado de sillón , Verificación de escupidera y bandeja, Verificación de negatoscopio, Verificación de Pieza de alta, Verificación de Pieza de baja, Verificación de Jeringa triple, Verificación de pedal, Verificación estado de lampara, Verificación de tanque reservorio de agua potable, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION MARCA SECA SN 5874320152524	CONVENIO 423	6009058006	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de Sistema y Componentes Eléctricos - Electrónico, Verificación de fugas de aire y agua , Inspección general de Dispositivo Medico, Verificación de mangueras y fugas de aire/agua, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION SECA SN 5874196139896	CONVENIO 423	6009058009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de soporte frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
TERMOMETRO ELECTRONICO DIGITAL	RECUPERACION NUTRICIONAL	60020590022-0029	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de soporte frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967

BALANZA DOBLE PANTALLA FUNCION MADRE/ BEBE REF 874	RECUPERACION NUTRICIONAL	60090590056-0059	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de DM, Limpieza externa - interna del DM, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sensores, Verificación de batería , Verificación de parámetro de programación , Verificación de ajuste de alarmas, Verificación de sensado de humedad, Verificación Funcional de	95.441	331.967
BALANZA DOBLE PANTALLA FUNCION MADRE/ BEBE REF 874	RECUPERACION NUTRICIONAL	60090590056-0059	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación Sistema Elctrico, Verificación de sistema y Componentes Electricos, Verificación de pantalla o panel frontal, Verificación de pulsadores y perillas de encendido y programación, Verificación de porta capsula , Verificación de parámetros de programación, Verificación de Revoluciones por minuto (R.P.M), Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
KIT TENSIOMETRO FONENDO ADULTO	RECUPERACION NUTRICIONAL	60090590081-0084	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
KIT TENSIOMETRO FONENDO PEDIATRICO	RECUPERACION NUTRICIONAL	60090590085-0088	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Elctrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
PESO DOBLE FUNSION, TALLIMETRO MOVIL INFANTOMETRO	RECUPERACION NUTRICIONAL	60090590089	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
TENSIOMETRO DE PARED MARK WELCHALLYN SERIAL 090491980	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620013	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
CAMA DE PARTO TIPO MECANICA COLOR BLANCO	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620022	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CALENTADOR PARA BEBES MARCA FISHER PRIKEL CON METAL Y MADERA MODELO 1W820 SERIAL 9520JHX95	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620024	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
SUCCIONADOR PARA BEBE MARCA THOMAS MEDI-PUMP SERIAL 070400016025	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620025	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
LAMPARA DE PARTO MODELO SEEMENS MODELO SRELUX 60 ER SERIAL 015 80	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620026	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema electrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Elctrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
ASPIRADOR PORTATIL MARCA THOMAS MODELO 1615 SERIAL 71400007118	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620027	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos, Verificación de manómetro: indicador y aguja, Verificación de fugas de aire, Inspección general de Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de	95.441	331.967
BALANZA PESA BEBE DIGITAL MARCA HEALTH O METER MODELO 522KL SERIAL 5220002636	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620029	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967

ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART R3 SERIAL 42002630	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620032	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara, Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
PULSOXIMETRO DE PULSO MARCA MINDRAY MODELO PM-50 SERIAL AY-08130604	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620033	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Electrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO F3 SERIAL M13901040037	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620080	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Electrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
MONITOR DE SIGNOS MARCA MINDRAY MODELO IMEC8 SERIAL 46011160	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620093	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara, Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
BASCULA PARA BEBE. COLOR BLANCO HUESO MARCA	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620103	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico, Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
BALANZA CON TALLIMETRO DIGITAL MARCA DETECTO BODY SCALE MODELO 20KG ACS-20BYE SERIAL 44544	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620111	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
PESO DIGITAL COLOR BLANCO, DOS TABLEROS	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620112	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
NEBULIZADOR MARCA DEVILBISS MODELO 5650D SERIAL D7013949	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620124	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
CARRO DE PARO	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620129	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico, Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA NACIONAL	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60050470007	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico, Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
MESA GINECOLOGICA	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60060500031	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
LAMPARA CISNE MARCA KRAMER	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620158	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967

CAMA METALICA MECANICA MARCA PRODUMENAL	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620174-0175	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
ESTERELIZADOR SECO, MARCA 1DIES TAPA BEISH	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620176	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de puerta y seguro de puerta, Verificación de puerta y seguro de puerta, Verificación de cargador, Lubricación y ajuste de sistema de puerta, Verificación de configuración de menu, Prueba de test de display, Prueba de test de teclado, Prueba de test de alarmas, Prueba de test de apertura de puerta, Prueba test de sensor de aire, Verificación de Presión sin circuito CH1 (48 a 52), Verificación de Presión con circuito CH1 (60 a 120), Verificación de Prueba de infusión CH1 (200ml/h 10ml +/-5%), Verificación de Presión sin circuito CH2 (48 a 52), Verificación de Presión con circuito CH2 (60 a 120), Verificación de Prueba de infusión CH2 (200ml/h 10ml +/-5%), Verificación de Presión sin circuito NOA3, Verificación de Presión con circuito NOA3, Verificación de Prueba de infusión NOA3 (200/10)ml/h(50%), Lectura Potenciometro CH1, CH2 (0,5 a 5) V, Verificación de la Batería, Verificación de la Batería	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698282	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620177	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4697909	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620178	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
COMPRESOR MARCA SCHUIZ MODELO MSV6 SERIAL 3244369	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620208	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de valvas rectas y curvas, Verificación de estado de batería, Verificación de estado de bombillo, Verificación de estado de fibra optica, Verificación de sistema eléctrico y encendido, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL COMPRESOR MARCA TROPHY	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60070620209-021	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaete, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarieta, bomba de	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620212	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de sistema Hidraulico, Verificación de estado de sillón , Verificación de escupidera y bandeja, Verificación de negatoscopio, Verificación de Pieza de alta, Verificación de Pieza de baja, Verificación de Jeringa triple, Verificación de pedal, Verificación estado de lampara, Verificación de tanque reservorio de agua potable, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de	95.441	331.967
AMALGAMADOR MARCA SDI MODELO ULTRAMAT 2 SERIAL 124318	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60080440001	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de sonda frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
LAMPARA DE FOTOCURADO MARCA COLTOLUX MODELO LED SERIAL 121109013	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60070620209-021	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de Sistema y Componentes Eléctricos - Electrónico , Verificación de fugas de aire y agua , Inspección general de Dispositivo Medico, Verificación de mangueras y fugas de aire/agua, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
PIEZA DE ALTA MARCA NSK MODELO PA-S B2 PANA AIR SERIAL 98030	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620212	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967

PIEZA DE BAJA MARCA NSK MODELO EX6B SERIAL SD24403	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	55040630145	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
CAVITRON CON PUNTA MARCA BIOSONIC MODELO S1 SERIAL 110551187C	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60070660051	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
AMALGAMADOR MARK GNATUS SERIAL 4522116063	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620223	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de parámetro y funciones, Verificación de transductor - Convexo, Verificación de transductor transvaginal, Verificación de transductor- Lineal, Verificación de sistema mecánicos, Verificación de posicionamiento y freno de brazo y tubo, Verificación de KA, Verificación de rayo, Verificación de parámetros de programación, Prueba funcional de Dispositivo Medico, verificación de colimador - revisión de panel de funciones de KV y mA	95.441	331.967
PIEZA DE ALTA NSK	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620230	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de parámetro y funciones, Verificación de transductor - Convexo, Verificación de transductor transvaginal, Verificación de transductor- Lineal, Verificación de sistema mecánicos, Verificación de posicionamiento y freno de brazo y tubo, Verificación de KA, Verificación de rayo, Verificación de parámetros de programación, Prueba funcional de Dispositivo Medico, verificación de colimador - revisión de panel de funciones de KV y mA	95.441	331.967
PIEZA BAJA VELOCIDAD- MICROMOTOR MARCA MTI 13010155 (punta mala)	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620230	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de parámetro y funciones, Verificación de transductor - Convexo, Verificación de transductor transvaginal, Verificación de transductor- Lineal, Verificación de sistema mecánicos, Verificación de posicionamiento y freno de brazo y tubo, Verificación de KA, Verificación de rayo, Verificación de parámetros de programación, Prueba funcional de Dispositivo Medico, verificación de colimador - revisión de panel de funciones de KV y mA	95.441	331.967
MICROMOTOR ORIGINAL MARCA NSK C7602663 1 MTI 2 NSK	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	60090620230	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de parámetro y funciones, Verificación de transductor - Convexo, Verificación de transductor transvaginal, Verificación de transductor- Lineal, Verificación de sistema mecánicos, Verificación de posicionamiento y freno de brazo y tubo, Verificación de KA, Verificación de rayo, Verificación de parámetros de programación, Prueba funcional de Dispositivo Medico, verificación de colimador - revisión de panel de funciones de KV y mA	95.441	331.967
TENSIOMETRO MARCA WELCHALLYN TYCOS S/N 080701132421	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630014	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
MONITOR DE SIGNOS MARCA MINDRAY MODELO IMEC8 SERIAL 46011158	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630017	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de parámetro y funciones, Verificación de transductor - Convexo, Verificación de transductor transvaginal, Verificación de transductor- Lineal, Verificación de sistema mecánicos, Verificación de posicionamiento y freno de brazo y tubo, Verificación de KA, Verificación de rayo, Verificación de parámetros de programación, Prueba funcional de Dispositivo Medico, verificación de colimador - revisión de panel de funciones de KV y mA	95.441	331.967
MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO F3 SERIAL M13901040029	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630018	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de transductor , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (suiche on/off, Parlante, potenciómetro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967
PESO DIGITAL COLOR BLANCO, DOS TABLEROS	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090620112	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electronico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967

BALANZA CON TALLIMETRO DIGITAL MARCA DETECTO MODELO 20KG ACS-20BYE SERIAL N/A	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630026	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electrónico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART R3 SERIAL 42002629	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630032	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Eléctrico y Electrónico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698255	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630038	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
MESA GINECOLOGICA MARCA MODELO SERIAL	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630042	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
ASPIRADOR PORTATIL MARCA THOMAS MODELO 1615 SERIAL(07140007108)	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630043	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
BALANZA PESA BEBE DIGITAL MARCA HEALTH O METER MODELO 522KL SERIAL 5220002650	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630045	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Eléctrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
CARRO DE PARO	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090620129	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Manguera y Brazaletes de NIBP, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Saturación de Oxígeno en la sangre (SpO2), Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de EKG y electrodos, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Temperatura (Piel), Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros SpO2 Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros NIBP Adulto - Neonato, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros EKG Adulto, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros Temperatura, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros IBP , Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Modulo de Capnografía, Inspección general de Dispositivo Medico - Cargador de batería Externo, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación funcional de Dispositivo Medico - Impresora sistema, Verificación de Set de Chupac y	95.441	331.967
LAMPARA CISNE MARCA KRAMER	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090620158	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de transductor , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (suiche on/off, Parlante, potenciómetro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967
LAMPARA MARCA NACIONAL CUELLO DE CISNE Y DAÑADO	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630057-0058	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de cable de paciente, latiguillos, chupas y pinzas, Verificación de Sistema electrónico , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (pantalla LCD, pulsadores, suiches, tarjeta electrónica), Verificación de estado de batería, Verificación de estado de impresora y papel, Verificación de parámetros de programación, Verificación con simulador de funcionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967

succionador gomco modelo 789 serial # 54553	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60050630085	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
BASCULA PARA ADULTOS MARCA KENWELL MODELO DT612 CAP 160 KG	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630098	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO ADULTO MARCA WELCH ALLYN MODELO 522 SERIAL N/A	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630101	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO MARCA WELCH ALLYN MODELO 315 SERIAL N/A	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630102	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de manómetro: indicador y aguja, Verificación de fugas de aire, Inspección general de Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de	95.441	331.967
NEBULIZADOR MARCA DEVILBISS MODELO 5650D SERIAL D7013977	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630103	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
PULSOXIMETRO DE PULSO MARCA MINDRAY MODELO PM-50 SERIAL AY-08130506	CENTRO DE SALUD SIAPANA	60090630104	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (cable de alimentación y suiche de encendido), Verificación de Sistema y Componentes Mecanicos, Verificación de estado de frasco de reservorio, Verificación de estado de mangueras y filtro Hidrofobico, Chequeo de fugas, Verificación de estado de manómetro de presión, Verificación de estado de motor pistones, rodamientos y ventilador, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de estado de pedal, Verificación de vacuometro (+/-1%), Verificación de válvula selectora, Prueba de Vacio máxima 600mmhg (+/- 5%), Verificación de estado de soporte y sistema de rodamiento, Ajuste y lubricación de sistema mecanico, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA STANLEY MODELO N/A SERIAL N/A	CENTRO DE SALUD SIAPANA	55040630145	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (cable de alimentación y suiche de encendido), Verificación de Sistema y Componentes Mecanicos, Verificación de estado de frasco de reservorio, Verificación de estado de mangueras y filtro Hidrofobico, Chequeo de fugas, Verificación de estado de manómetro de presión, Verificación de estado de motor pistones, rodamientos y ventilador, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de estado de pedal, Verificación de vacuometro (+/-1%), Verificación de válvula selectora, Prueba de Vacio máxima 600mmhg (+/- 5%), Verificación de estado de soporte y sistema de rodamiento, Ajuste y lubricación de sistema mecanico, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
NEBULIZADOR MARCA THOMAS MEDICAL PUMP SERIAL 120600001464	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090640008	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de sistema Hidraulico, Verificación de estado de sillón , Verificación de escupidera y bandeja, Verificación de negatoscopio, Verificación de Pieza de alta, Verificación de Pieza de baja, Verificación de Jeringa triple, Verificación de pedal, Verificación estado de lampara, Verificación de tanque reservorio de agua potable, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de	95.441	331.967
PESO DIGITAL COLOR BLANCO, DOS TABLEROS	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090620112	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de sistema Hidraulico, Verificación de estado de sillón , Verificación de escupidera y bandeja, Verificación de negatoscopio, Verificación de Pieza de alta, Verificación de Pieza de baja, Verificación de Jeringa triple, Verificación de pedal, Verificación estado de lampara, Verificación de tanque reservorio de agua potable, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de	95.441	331.967
MONITOR DE SIGNOS MARCA MINDRAY MODELO IMEC8 SERIAL 46011160	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090620093	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo Medico, Limpieza de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación Sistema Electrico, Verificación de sistema y Componentes Electricos, Verificación de pantalla o panel frontal, Verificación de pulsadores y perillas de encendido y programación, Verificación de porta capsula , Verificación de parámetros de programación, Verificación de Revoluciones por minuto (R.P.M), Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967

PULSOXIMETRO DE PULSO MARCA MINDRAY MODELO PM-50 SERIAL AY-08130604	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090620033	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de soporte frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
LAMPARA PIELITICA MARCA ORDISI SERIAL 15156	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090640026	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de Sistema y Componentes Eléctricos - Electrónico , Verificación de fugas de aire y agua , Inspección general de Dispositivo Medico, Verificación de mangueras y fugas de aire/agua, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
NEGATOSCOPIO MARCA NACIONAL MODELO 1 CUERPO	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090640027	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
PESO KENWELL COLOR BLANCO PISO DE CAUCHO NEGRO SN BD10022599	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	60090640029	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de sistema mecanico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de sistema Hidraulico, Verificación de estado de sillón , Verificación de escupidera y bandeja, Verificación de negatoscopio, Verificación de Pieza de alta, Verificación de Pieza de baja, Verificación de Jeringa triple, Verificación de pedal, Verificación estado de lampara, Verificación de tanque reservorio de agua potable, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO ADULTO MARCA WELCH ALLYN MODELO 522 SERIAL N/A	C.S PARAISO ENFERMERIA	60090630101	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO MARCA WELCH ALLYN MODELO 315 SERIAL N/A	C.S PARAISO ENFERMERIA	60090630102	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (cable de alimentación y suiche de encendido), Verificación de Sistema y Componentes Mecanicos, Verificación de estado de frasco de reservorio, Verificación de estado de mangueras y filtro Hidrofobico, Chequeo de fugas, Verificación de estado de manómetro de presión, Verificación de estado de motor pistones, rodamientos y ventilador, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de estado de pedal, Verificación de vacuometro (+/-1%), Verificación de válvula selector, Prueba de Vacío máxima 600mmhg (+/- 5%), Verificación de estado de soporte y sistema de rodamiento, Ajuste y lubricación de sistema mecanico, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
BALANZA CON TALLIMETRO DIGITAL MARCA DETECTO BODY SCALE MODELO 20KG ACS-20BYE SERIAL 44544	C.S PARAISO ENFERMERIA	60090620111	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (cable de alimentación y suiche de encendido), Verificación de Sistema y Componentes Mecanicos, Verificación de estado de frasco de reservorio, Verificación de estado de mangueras y filtro Hidrofobico, Chequeo de fugas, Verificación de estado de manómetro de presión, Verificación de estado de motor pistones, rodamientos y ventilador, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de estado de pedal, Verificación de vacuometro (+/-1%), Verificación de válvula selector, Prueba de Vacío máxima 600mmhg (+/- 5%), Verificación de estado de soporte y sistema de rodamiento, Ajuste y lubricación de sistema mecanico, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
MESA GINECOLOGICA	C.S PARAISO SALA DE PARTO	60060500031	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
LAMPARA CISNE MARCA KRAMER	C.S PARAISO SALA DE PARTO	60090620158	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de transductor , Verificación de componentes Eléctricos y/o Electrónicos (suiche on/off, Parlante, potenciómetro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967

ASPIRADOR PORTATIL MARCA THOMAS MODELO 1615 SERIAL 71400007118	C.S PARAISO SALA DE PARTO	60090620027	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Manguera y Brazaete de NIBP, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Saturación de Oxígeno en la sangre (SpO2), Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de EKG y electrodos, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Temperatura (Piel), Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros SpO2 Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros NIBP Adulto - Neonato, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros EKG Adulto, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros Temperatura, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros IBP , Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Modulo de Capnografía, Inspección general de Dispositivo Medico - Cargador de batería Externo, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación funcional de Dispositivo Medico - Inversores internos, Verificación de Set de Chupón y	95.441	331.967
BALANZA PESA BEBE DIGITAL MARCA HEALTH O METER MODELO 522KL SERIAL 5220002636 (38)	C.S PARAISO SALA DE PARTO	60090640061	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
AUTOCLAVE AUTOMATICO MARCA MINIKLAV-GV MODELO 21-34 SERIAL 14111481	C.S PARAISO COCINA	60020640104	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de estado de batería, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación de sensor Spo2, Verificación de estado de pantalla y de panel de teclado , Verificación de menu, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado cargador de batería	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4698282	C.S PARAISO HOSPITALIZACION	60090620177	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación sistema eléctricos., Verificación de componentes eléctricos - electrónicos., Verificación de bombillo, Verificación de fibra óptica y filtro UV, Verificación de control de exposición e intensidad luminica, Verificación de tiempo de exposición de rayo UV, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de tiempo de exposición de luz infraroja, Verificación de estado de brazo mecánico de posicionamiento, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de filtros, lentes y prismas, Verificación de estado oculares, Verificación de rayo de luz, Verificación de mando de control, ajuste y lubricación, Verificación de sonda frontal, Verificación de Sistema y Componentes	95.441	331.967
CAMA ELECTRICA MARCA HOSPITAL BED MODELO KY411D-53 SERIAL 4697909	C.S PARAISO HOSPITALIZACION	60090620178	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico,	95.441	331.967
CARRO DE PARO	C.S PARAISO HOSPITALIZACION	60090620129	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecánicos, Verificación de manómetro: indicador y aguja, Verificación de fugas de aire, Inspección general de Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de estado de valvula reguladora, Verificación de	95.441	331.967
ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MINDRAY MODELO BENEHEART R3 SERIAL 42002630	C.S PARAISO HOSPITALIZACION	60090620032	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire), Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
MONITOR FETAL MARCA EDAN MODELO F3 SERIAL M13901040037	C.S PARAISO HOSPITALIZACION	60090620080	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico Dispositivo medico - Cable de Alimentación AC, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Carcasa - Pantalla - Panel de Teclado y Mouse Rotador, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Manguera y Brazaete de NIBP, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Saturación de Oxígeno en la sangre (SpO2), Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Cable de EKG y electrodos, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Sensor de Temperatura (Piel), Limpieza general del Dispositivo Medico, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros SpO2 Adulto - Neonatos, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros NIBP Adulto - Neonato, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros EKG Adulto, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros Temperatura, Prueba funcional de Dispositivo Medico - Parámetros IBP , Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Modulo de Capnografía, Inspección general de Dispositivo Medico - Cargador de batería Externo, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico , Verificación funcional de Dispositivo Medico - Inversores internos, Verificación de Set de Chupón y	95.441	331.967
NEBULIZADOR MARCA DEVILBISS MODELO 5650D SERIAL D7013949	C.S PARAISO HOSPITALIZACION	60090620124	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico,	95.441	331.967

TENSIOMETRO MARCA SPHYGMANOMETER SERIAL 50350	C.S WARPANA	60090650009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Elctrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967
LAMPARA DE CISNE	C.S WARPANA	60090650013	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara, Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarieta, bomba de	95.441	331.967
Balanza Kenwell mod DT612	C.S WARPANA	60090650020	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
CAMA DE PARTO TIPO MECANICA COLOR GRIS	C.S WARPANA	60090630052	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de Membrana Grande/pequeña, Verificación de Campana Grande/Pequeña, Verificación de Olivas, Verificación de Aro Grande/ Pequeño, Verificación Funcional, Verificación de manguera	95.441	331.967
BASCULA PARA BEBE MARCA HEALTH OMMETER MODELO 30 KG	P.S VILLA FATIMA	60090660009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Inspección de estado físico Dispositivo Medico - Batería, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Transductor FHR, Inspección de estado físico de Accesorio de Dispositivo Medico - Toco, Inspección de estado físico Accesorio Dispositivo Medico - Marcador de Eventos, Limpieza general de los cables, sensores y accesorios del Dispositivo Medico, Verificación de parámetros de programación, Verificación de estado físico funcional de impresora + papel, Verificación de panel frontal, pantalla y teclado, Verificación de Sistema y Componentes Electrónico, Verificación de transductor, Verificación de componentes Elctricos y/o Electronicos (suiche on/off, Parlante, potenciometro de volumen, Verificación de estado de pantalla, Prueba	95.441	331.967
LAMPARA CUELLO CISNE CROMADA	P.S VILLA FATIMA	60090660018	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de Equipos y Accesorios, Limpieza de Equipo, Verificación sistema eléctrico, Verificación de batería, Verificación Sistema Electrico, Verificación de cabezote de Oftalmoscopio, Verificación de cabezote de Otoscopio, Verificación de conos, Verificación de estado sistema de carga de batería litio, Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado fuente de luz, Verificación de cable entorchado y conectores de mango	95.441	331.967
UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA KROMADENT MODELO ELECTRICA	P.S VILLA FATIMA SALA DE ESPERA	60070660051	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Elctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia, Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos, Prueba funcional de Dispositivo Medico	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION MARCA SECA SN 5874256143238	ALMACEN	60090140041	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico, Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico, Ajuste, Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION MARCA SECA SN 5874196139896	ALMACEN	60090140044	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaletes, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara, Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de paral con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (pantalla - display), Verificación de Sistema electrónico (tarieta, bomba de	95.441	331.967
BALANZA DOBLE FUNCION MARCA SECA SN 5874196139896	ALMACEN	60090140047	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico, Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecanico, Verificación de componentes mecanicos, Verificación de Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes electricos y electronicos, Verificación de peso en repetibilidad, Verificación de indicador numérico analogo, Verificación de indicador numérico digital, Verificación de plataforma o plato porta bebe, Verificación barra oscilante, Verificación de contrapeso, Verificación de plataforma, Ajustes de sistema punto (cero), Verificación Funcional de Dispositivo medico, Verificación de estado de tallimetro	95.441	331.967

SUCCIONADOR MARCA THOMAS MODELO :MEDIPUMP 1240 SN 70400001111	ALMACEN	60090140050	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección de estado físico y funcional de Dispositivo Medico., Limpieza externa - interna del Dispositivo Medico, Verificación de sistema mecánico (manómetro), Verificación de Cámara y brazaete, Verificación de Pera y Valvula, Verificación de indicador análogo (manómetro), Verificación de presión y fugas en pera y cámara , Verificación de manguera entorchada, Verificación de sistema de atril de pared, Verificación de sistema de parol con rodachines - estado de llantas y frenos, Verificación de manguera entorchada, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Verificación de indicador digital (mantalla - displav), Verificación de Sistema electrónico (tarjeta, bomba de	95.441	331.967
NEBULIZADOR MARCA DEVILBISS MODELO 5650D SERIAL D7013946	ALMACEN BODEGA	60090140009	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos. Prueba funcional de Dispositivo Medico.	95.441	331.967
MAQUINA DE SUCCION MODELO 7000 PROBASIC	ALMACEN BODEGA	60090140010	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico y Electronico, Verificación de componentes Eléctricos y/o Electronicos, Verificación de Resistencia , Verificación tanque reservorio de agua, conectores y tubería de drenaje, Verificación de Manómetro de Temperatura, Verificación de Manometro de Presión, Verificación de Parámetros Programables (temperatura /Presión), Verificación de Valvulas y Electrovalvulas, Ajustes de parámetros de programación según sean requeridos. Prueba funcional de Dispositivo Medico.	95.441	331.967
MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA LABOMED MODELO LX400 SERIAL 140163440	ALMACEN BODEGA	60020140011	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico. Ajuste. Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
FONENDOSCOPIO PEDIATRICO MARCA WELCH ALLYN MODELO 315 SERIAL N/A	ALMACEN BODEGA	60090630102	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico. Ajuste. Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
CAVITRON CON PUNTA MARCA BIOSONIC MODELO S1 SERIAL 111151100B	ALMACEN BODEGA	60090140024	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección general de Dispositivo Medico, Limpieza general del Dispositivo Medico, Verificación de Sistema Mecánico , Verificación funcional de posicionamiento de partes y accesorios ajustables, Verificación de Sistema Hidraulico/Neumatico, Verificación de sistema de freno, Verificación de sistema de seguridad de baranda, Chequeo de sistema trendelemburg, Verificación de ruedas, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Ajuste y lubricación en sistema mecanico. Ajuste. Verificación de sistema eléctrico/electrónico y	95.441	331.967
SUCCIONADOR MARCA THOMAS MODELO :MEDIPUMP 1240 SERIE:70400001111	ALMACEN BODEGA	60090140025	Trimestral	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	SOLUCIONES BIOMEDICAS DEL NORTE SAS	Inspección General de Dispositivo Medico, Verificación Sistema Electrico, Verificación de Componentes Electricos Electronicos, Verificación de Sistema Neumatico, Verificación de Sistema Mecanico - Motor, Verificación de Componentes Mecanicos, Prueba funcional de Dispositivo Medico, Verificación de Capacidad de Carga del Tanque, Verificación Funcional de Dispositivo Medico, Purgar sistema y circuito neumatico, Verificación estado de mangueras (chequeo de fugas de aire). Verificación de estado de filtro	95.441	331.967
COMPUTADOR CON:CPU MARCA INTELCELERON S/N 003205, MONITOR MARCA LG FLATRON, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO GENIUS S/N XEE407019927	ADMISIONES 2	70020010010	CUATRIMESTRE	FEB, JUNIO, OCTUBRE	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza, diagnostico de partes Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR	ALMACEN BODEGA	70020010025	TRIMESTRAL	FEB, JUNIO, OCTUBRE	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza, diagnostico de partes Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR - PORTATIL MARCA TOSHIBA SERIAL ZB211267W DISPLAY PARTIDO	ALMACEN BODEGA	70020020007	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza, diagnostico de partes Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR SIN CPU	ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS	70020030022	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON MONITOR MARCA HP COMPU MAX PC TODO EN USO CON AUDIO (SONIDO), TECLADO MARCA HP SERIAL 643691-161, MOUSE MARCA GENIUS SERIAL N° 505062-001	GERENCIA	70020040002	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR CON: MONITOR ACER MOD AL1706 SNID 70401127439, TECLADO MARCA MICROSOFT SERIAL 0200701891165, MOUSE MARCA GENIUS, CPU MARCA XTECH SERIAL HS129052612129	VACUNACION	70020050006	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA MICROMAC SIN SERIAL, MONITOR HACER, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA GENIUS SERIAL 071003617	CONSULTORIO MEDICO 5	70020060005	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA XTECH SERIAL HS24052612073, MONITOR MARCA AOC E 960SWN S/N ANGC30H0003164 PARLANTES AUDIO, MOUSE MARCA HP CPU MARCA HP SERIAL MXJ90902T7, TECLADO MARCA MICROSOFT S/N 0200701891276	LABORATORIO	70020070015	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU SIN MARCA S/N 20710228, MONITOR MARCA ACER AL1706 S/N ETL 460C148629090FB4001 (PARLANTES MARCA GENIUS), MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA GENIUS SERIAL XE6604038206	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	70020080008	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU INTEL CORE, MONITOR LG FLATRON W1943SB SERIAL ZXTMHYLF1056479, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO JANS MUAC JSKBMS COMBO 10152035	ESTADISTICAS	70020090007	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU INTELCELERON MODELO POWER GROUP SIN SERIAL, MONITOR SAMSUNG LED 19" S/N ZXTMH4LF105850, MONITOR SAMSUNG LED 19" S/N, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA GENIUS	CITOLOGIA	70020100007	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU INTELCELERON S/N 00312 COLOR NEGRO, MONITOR MARCA LG FLATON W1742S SERIAL 007TPVHIP847, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA BLANCO	ESTADISTICAS	70020110005	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU LENOVO SERIAL 11S0C64966ZVJ8AK42VOGA, MONITOR LENOVO V4C4365, TECLADO, MOUSE	SECRETARIA DE TALENTO HUMANO	70020120014	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR CON: CPU MARCA INTEL INSIDE PENTIUM MODEL CS500GDS93, MONITOR MARCA LG FLATRON 20EN33SS, MOUSE MARCA GENIUS YB37C1U228862, TECLADO MARCA MICROSOFT 0200702140368	SIAU	70020130001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA INTEL CELERON S/N 003205, MONITOR MARCA AOC 716 SW S/N 03276JA065894, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA GENIUS ZM6A07038446	ADMISIONES 1	70020150019	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA JANUS SERIAL 10120489621, MONITOR MARCA LG FLATRON W1742S S/N 007TPTM1P185, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA JANUS SERIAL JKBMCOMBO 1015652N	CONSULTORIO MEDICO 1	70020170001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA COMPUMMAX INTE CORE S/N XXX, MONITOR LG FLATRON W2D43EI S/N 912UXMT2P139- PARLANTES, MOUSE GENIUS S/N 160109507846, TECLADO GENIUS KB 110X SERIAL GK10011	COMPRAS	70020170011	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA COMPUMMAX SERIAL LO15N21747, MONITOR MARCA AOC MODELO 716SW SERIAL D3276JA0795, MOUSE MARCA GENIUS S/N X3G8407504895C, TECLADO MARCA GENIUS	FARMACIA	70020180001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA HP PROLIANT ML15066 S/N MXS9270JSU, MONITOR MARCA LG FLATRON W2043SE SERIAL 9112UXUN2N062, TECLADO GENIUS X3GB4007504853, MOUSE GENIUS X3GB4007504853	COORDINADOR DE FACTURACION	70020180020	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA HP SERIAL MXJ90902T7, MONITOR MARCA HP L1710 S/N 3C09010DFS, MOUSE MARCA MICROSOFT, TECLADO SIN MARCA	LABORATORIO	70020180064	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA JANUS SM 10120684815, MONITOR MARCA EM VISION S.M 90868CA005655 COLOR GRIS CON NEGRO, MOUSE GENIUS DX 120 SN X5K92093207313, TECLADO USB GENIUS KB - 125 SN UD1612603516	BODEGA FARMACIA	70020180066	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR CON: CPU MARCA POWER GROUP NEGRO SN CS500GDS93, MONITOR, MOUSE GENIUS, TECLADO GENIUS	CONTROL INTERNO	65020190018	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU SIN SERIAL, MONITOR MARCA LG W17425 S/N 007TPDT1P882, MOUSE MARCA JANUS, TECLADO MARCA JANUS SERIAL JSKBMS COMBO 10 15237	CONSULTORIO MEDICO 3	7002020015	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA ACER MODELO X183H SERIAL ETL6080011930072244210, TECLADO MARCA GENIUS MODELO GK 070006 SERIAL YB26C1U07542, MOUSE GENIUS SN YB37C1U28864, CPU MARCA POWER GRUOP SERIAL I322POR25138X0	OFICINA RIOHACHA	7002020016	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA ACER MODELO AL 1706 SERIAL ETL460C148628C82DE4001 CON(AUDIO PARLANTE) GENIUS SN YQX608701452, MOUSE MARCA GENIUS COLOR NEGRO SN X3G84007504853, TECLADO GENIUS COLOR NEGRO SN WE3992086864, CPU MARCA INTERPENTIUM	VACUNACION	70020210001F1	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA COMPAQ MODELO 18 SERIAL 5CM2380JLR, TECLADO MARCA COMPAQ SERIAL 505130-161, MOUSE MARCA HP SERIAL 697738-001	OFICINA RIOHACHA	70020210001F2	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR con: MONITOR MARCA COMPAQ MODELO COMPAQ18 SERIAL 5CM2390H5Y (AUDIO PARLANTE), TECLADO MARCA COMPAQ SERIAL 505130-161, TECLADO MARCA COMPAQ SERIAL 505130-161, TECLADO MARCA COMPAQ SERIAL 505130-161, MOUSE MARCA COMPAQ SERIAL 697738-001	OFICINA RIOHACHA	70020210002F3	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA LG FLATRON MODELO W17425-B SERIAL 007TPVH1N887, TECLADO MARCA GENIUS XEE407019929, MOUSE MARCA HP, CPU MARCA JANUS REF 10120484620	VACUNACION	70020220080	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA LG FLATRON W1943C COLOR NEGRO SM204NDFV02939, TECLADO MARCA GENIUS SM 6K070006/U, MOUSE MARCA GENIUS, C.P.U MARCA POWER	ALMACEN	70020220081	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA LG S/N 912UXNU2P095 FLATON W2043SE, CPU MARCA COPUMAX S/N 10TSN21761, MOUSE MARCA SANUS, TECLADO MARCA GENIUS	PAGADURIA	7002023021	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR 90868CA007866 ENVISION, CPU INTEL CORE SIN SERIAL, MOUSE GENIUS 128012504911, TECLADO GENIUS YB2111008583	OFICINA P Y P	70020240002	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR AOC NEGRO E960SWN, CPU COMPUMAX INTEL CORISION AME, MOUSE GENIUS, TECLADO GENIUS	OFICINA P Y P	70020240075	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: monitor led lg 19.5 model 20m37 SN 601Intpc5m504, cpu compumaz model 1019-900-0049 SN 102sn18745, teclado compumax y mouse compumax, regulador dijital 10monas ref 8005r SN 15277788463	PEDIATRIA	70020240083	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: monitor led lg 19.5 model 20m37 SN 601Intdvcx218, teclado compumax y mouse compumax, cpu compumaz model 1019-900-0049 SN 102sn18986	HOSPITALIZACION	70020260001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR LG S/N 912UXMT2P239, CPU LANUX, TECLADO GENIUS S/N XP135S804854, 1 MOUSE	COSTOS	7002029011	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA ACER S/N ETL5108454628043BT4203, CPU MARCA INTELCELERON SERIAL 00003446, TECLADO MARCA GENIUS S/N X36604038261, MOUSE MARCA GENIUS	ODONTOLOGIA 2	7002029017	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA LENOVO SERIAL 60 8AAR6USV900FCD5, CPU MARCA LENOVO SERIAL 11SOC64966ZVJ8AK49V169, TECLADO MARCA LENOVO 1S54Y94247415448E, MOUSE MARCA LENOVO SN 45J4888	CONTADURIA	7002030019	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA LG 209NDRF9L902, CPU MARCA MAKJANUS INTELCELERON S/N 10121585509, MOUSE MARCA SANUS, TECLADO MARCA GENIUS S/N CZCE941501543	PRESUPUESTO	70020310027	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR CON: MONITOR NEGRO MARCA SAMSUNG ZBBNHVJBA00662Z, CPU MARCA ARGON SERIAL SQ5900044015ZF, MOUSE GENIUS, TECLADO GENIUS	SUBDIRECCION CIENTIFICA	70020330031	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR SAMSUNS19C150, TECLADO GENIUS, MOUSE GENIUS, CPU COMPUMAX INTEL CORE	OFICINA P Y P	0340020	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR, TECLADO MARCA GENIUS MODELO K 645, MOUSE MARCA DELL, CPU SIN SERIAL XXXX	COORDINADOR DE FACTURACION	70020350026	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA LG FLATRON W1943SB S/N 9070XGL5X015, TECLADO MARCA GENIUS XB28C1U07544, MOUSE MARCA LANUS, CPU SIN SERIAL	FACTURACION 2	70020360031	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR LG SN 204NDUN03054, CPU MARCA POWER GROUP NEGRO, MOUSE MARCA GENIUS YB22C1UI5745, TECLADO MARCA GENIUS YB22C1UI5745	OFICINA P Y P	70020370018	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU MARCA COMPUS MAX SIN SERIAL, MONITOR MARCA LG SM 9120XTF2N070 FLATON 2 AUDIO PARLANTE MARCA GENIUS, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA GENIUS SIN SERIAL COLOR NEGRO	TALENTO HUMANO	70020370019	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: CPU POWER GROUP, TECLADO MARCA GENIUS MODELO K 645, MOUSE MARCA GENIUS, MONITOR LG 907UXAY5V320	FACTURACION 3	55220380001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA ACER AL 1706 S/N ETL510895428041EA203 (PARLANTE AUDIO AITEG), TECLADO MARCA GENIUS MODELO K645 S/N ZM9307045701, MOUSE MARCA HP, CPU MARCA INTEL CELERON SIN SERIAL	ODONTOLOGIA 1	55220390001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR CON: MONITOR MARCA ACER AL1706 S/N ETL 460C1486380FE604001 (PARLANTE AUDIO MARCA GENIUS MODELO SP110), MOUSE MARCA GENIUS, CPU MARCA INTRECOL SIN SERIAL	FACTURACION 1	70020400019	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR CON:monitor led lg 19.5 model 20m37 SN 510ntfa6g987. cpu compumaz model 1019-900-0009 SN 102sn18466, teclado compumax y mouse compumax, regulador digital 10monas ref 8005r SN 1527788459	CONSULTORIO MEDICO 2	70020420007	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR LENOVO PB00X4CV CON: MONITOR LENOVO V4C4354, MOUSE LENOVO, TECLADO LENOVO 5938714	CALIDAD	70020460098	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR LENOVO pb00x4f8 CON: MONITOR LENOVO S/N 03X7951, MOUSE LENOVO HS408HDD0BV, TECLADO LENOVO	COORDINACION MEDICA	70020560093	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR LENOVO PB00X4F8 CON: MONITOR LENOVO V4C3523, MOUSE GENIUS XEE407019930, TECLADO GENIUS SN XEE407019930	ARCHIVO	70020590107	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR LG FLATRON W1742S S/N 007TPED1P620, CPU MARCA JANUS SIN SERIAL, MOUSE MARCA GENIUS, TECLADO MARCA JANUS SIN SERIAL	CONSULTORIO MEDICO 4	70010610001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR MARCA AOC E960SWH S/N ANGC304003575 CON: TECLADO MARCA MICROSOFT 0200702140368, MOUSE SIN MARCA COLOR NEGRO, CPU MARCA XTECH VISION S/N CSS10GNC58-111800625	ADMISIONES REF Y CONTRA.REF	70020610012	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR MONITOR MARCA LG FLATON SERIAL 912UXUN2U062 COLOR NEGRO, TECLADO MARCA GENIUS,MOUSE MARCA JANUS, CPU MARCA POWER GROUP INTEL CORE I3	SECRETARIA DE GERENCIA	70020610042	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR ODONTOLOGIA con:MONITOR LG SERIAL 209NDGL911, TECLADO GENIUS MODELO K 645 S/N XD133S876238, MOUSE MARCA GENIUS S/N, CPU MARCA POWER GRUOP, UPS MARCA ASUM AS-P500	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	70020620198	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR PORTATIL HP 14-R230LA SN CND5074M59	RECUPERACION NUTRICIONAL	70020260001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR: MONITOR LED LG 19,5 MODEL 20M37 SN 510NTC2411011,CPU COMPUMAZ MODEL 1019-900-0009 SN102SN18418, CON:teclado compumax y mouse compumax,	CONSULTORIO MEDICO 5	70020140001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

COMPUTADOR: MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 943 NWX SERIAL N MY19T14NQ205971L, TECLADO OMEGA MARCA ATK 2001 FC, MOUSE GENIUS S/N 156081502507, CPU POWEER COD 32-04	MANTENIMIENTO	70020140037	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
COMPUTADOR: MONITOR MARCA SAMSUNG MODELO SYNC MASTER 943 NWX SERIAL N MY19T14NQ205971L, TECLADO OMEGA MARCA ATK 2001 FC, MOUSE GENIUS S/N 156081502507, CPU POWEER COD 32-04	MANTENIMIENTO	70020140039	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
FOTOCOPIADORA RICOH ATICIO MP 2510	COPIAS	70020010026	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
FOTOCOPIADORA SHARP MODELO AL 2040CS SERIAL 1500393X	COPIAS	70020020008	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
FOTOCOPIADORA TOSHIBA CON BASE METALICA	COPIAS	70020030023	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA HP LASER JET P1102W	CRECIMIENTO Y DESARROLLO	70020070014	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO LASERJET P1102W SERIAL NO. VND3500513	OFICINA RIOHACHA	70020100007	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA CANON MODELO MP190 COLOR GRIS	MANTENIMIENTO	70020120018	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA CANON MODELO MP190 SERIAL QC2-9019DB0101 COLOR GRIS	PAGADURIA	65020130002	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA HP LASER JET 1018 S.M CNB1436554	CITOLOGIA	65020130003	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA HP LASER JET P1006 NFMFP S/N VDND3214233 COLOR GRIS	PRESUPUESTO	65020170022	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET M 1212NFMFP S/N CNQ90292X5 MULTIFUNCIONAL	ALMACEN	65020180002	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER P3015 S/N VNBCB4BYM COLOR GRIS	FACTURACION 3	65020210001F3	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA CANON	MANTENIMIENTO	65020210001BF	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA CANON PIXMA S/N KKD05630	FACTURACION 3	70020220082	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA EPSON L210 MILTIFUNCIONAL	RECUPERACION NUTRICIONAL	7002023021	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA EPSON LX 350 SN Q75Y018693	PAGADURIA	65020240001	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA HP COLOR BLANCA P2D14N SN CNQJ5885	ODONTOLOGIA 1	65020260008	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA HP LASER 1536DNF CON SERIAL RVXZ014690	ARCHIVO	65020270031	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

IMPRESORA HP LASER JET M 1212NI MFP MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO S/NG 9D292W7	SUBDIRECCION CIENTIFICA	7002029012	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA HP LASERJET 1102W SN VND 3510816	ALMACEN BODEGA	70020310028	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA LASERJET 1536 DNF MF PCNG8G167BP	OFICINA P Y P	65020320004	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA EPSON STYLUS T24 SERIAL LBRP00884L (084)	ALMACEN BODEGA	65020320005	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA EPSON SERIAL S25K215375	PUESTO DE SALUD PUERTO ESTRELLA	65020320006	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA HP LASER JET P 1006 SM VND3214588 COLOR GRIS CLARO OSCURO	SECRETARIA DE TALENTO HUMANO	70020350027	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA HP SERIAL	FARMACIA	60080380023	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA LEXIMARK 2613 S/N 07045406727 COLOR GRIS OSCURO	ALMACEN BODEGA	65020400024	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MARCA SAMSUNG SCM 3408W BLANCA	CONSULTORIO MEDICO 3	70020420008	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SN W98Y042305	COORDINADOR DE FACTURACION	7002058022	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 1536DNF SERIAL CND9D32BMC	VACUNACION	70020590110	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 KKDX05630	ALMACEN BODEGA	65020610021	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210 *S25K072019*	SIAU	65020620001-000	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 1536 DNF S/N CNC9021BQV	ADMISIONES 1	65020640002	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP M127FN S/N CNB9G581VY	LABORATORIO	65020260008	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET 1536 ANF MFP SERIAL 6NC9D21BR5	SECRETARIA DE GERENCIA	65020140003	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET 1536 DNF SN CNC9CCRC4K R COLOR NEGRO	C.S PARAISO CONSULTORIO MEDICO	65020140063	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP LASER JET 1536DNFP SERIAL SM CNC9D21BQY	TALENTO HUMANO	65020140067	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 SN KKDX03523	URGENCIAS	65020140069	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2100 SN KKDX03563	CONVENIO 423	65020140070	TRIMESTRAL	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	RICARDO ANDRES SOTO WISMAN	Mantenimiento Preventivo (Revisión de contactos entre partes, limpieza de disco duro por virus e información, diagnostico de partes como Disco Duro, Board, memorias, revisión de controladores y software, limpieza en general de hardware	137.760	479.167

AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUSIER PLACA FWU-214	NAZARETH	75020680007	MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	taller el desvare	Cambio de aceite y filtro, revision valvulina transmisiones, liquido de frenos, aceite hidraulico direccion, aceite caja y transfer, agua de bateria, ajuste de frenos, revision muelles, amortiguadores, gomas,revision luces, revision aire.	402.500	4.830.000
AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUSIER PLACA FWU-214	NAZARETH	75020680007	MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	taller el desvare	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.300.000	27.600.000
AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUSIER PLACA OZJ991	PARAISO	75020680008	MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	taller el desvare	Cambio de aceite y filtro, revision valvulina transmisiones, liquido de frenos, aceite hidraulico direccion, aceite caja y transfer, agua de bateria, ajuste de frenos, revision muelles, amortiguadores, gomas,revision luces, revision aire.	402.500	4.830.000
AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUSIER PLACA OZJ991	PARAISO	75020680008	MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	taller el desvare	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	2.300.000	27.600.000
PLANTA IVECO	PLANTAS ELECTRICAS		UNICO	ABRIL	PERSONAL EXTERNO	CAMBIO DE MOTOR	46.000.000,0	46.000.000
PLANTA ELECTRICA CUMMINS 75 KVA	PLANTAS ELECTRICAS		MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	PERSONAL MANTENIMIENTO	Limpieza, inspeccion, cambio de aceites filtros de aceite acpm, calibracion,revision sistema electrico, revision baterias	1.725.000,0	20.700.000
PLANTA ELECTRICA CUMMINS 75 KVA	PLANTAS ELECTRICAS		ANUAL	JULIO	RENATO VERGARA	REPARACION GENERAL	35.000.000,0	35.000.000,0
PLANTA ELECTRICA OLIMPIAN 150KW	PLANTAS ELECTRICAS	38-04	MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	PERSONAL MANTENIMIENTO	Limpieza, inspeccion, cambio de aceites filtros de aceite acpm, calibracion,revision sistema electrico, revision baterias	1.725.000,0	20.700.000
PLANTA ELECTRICA OLIMPIAN 150KW	PLANTAS ELECTRICAS	38-04	ANUAL	AGOSTO	RENATO VERGARA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO DE MOTOR	46.000.000,0	46.000.000
PLANTA ELECTRICA LISTER 75KW	PLANTAS ELECTRICAS	38-05	ANUAL	AGOSTO	PERSONAL EXTERNO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	35.000.000,0	35.000.000,0
PLANTA ELECTRICA LISTER 75KW	PLANTAS ELECTRICAS	38-05	MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	PERSONAL MANTENIMIENTO	Limpieza, inspeccion, cambio de aceites filtros de aceite acpm, calibracion,revision sistema electrico, revision baterias	1.725.000,0	20.700.000
PLANTA ELECTRICA CHINA	C.S. SIAPANA		MENSUAL	EN,FEB,MAR,ABR,MAY,JUN.J UL,AG,SEP,OCT,NOV,DIC	PERSONAL MANTENIMIENTO	Limpieza, inspeccion, cambio de aceites filtros de aceite acpm, calibracion,revision sistema electrico, revision baterias	345.000,0	4.140.000